


ДАЖ-23 Инструкция по изменению сетевых настроек дозатора

Если вы не знаете текущий IP адрес автосамплера, то сбросьте его настройки [следующим образом](#). Дозатор будет иметь IP адрес по умолчанию 192.168.201.1.

Подключите автосамплер и компьютер прямым кабелем. Либо удостоверьтесь, что к свитчу подключён только автосамплер и компьютер.


Отключите прокси сервер в настройках браузера [согласно инструкции](#).

Подключитесь через браузер (Internet Explorer, Chrome, Microsoft Edge или любой другой) к дозатору введя в адресную строку браузера его IP адрес.

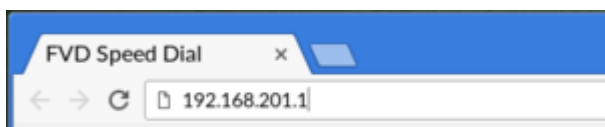


Вводим имя пользователя и пароль.


По умолчанию имя пользователя **user**, пароль **password**

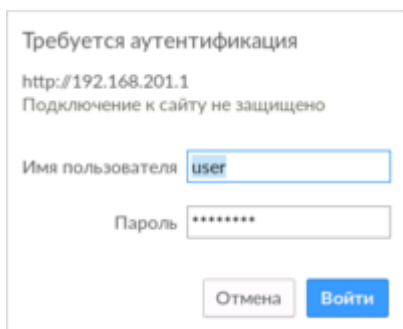A screenshot of an authentication dialog box. The title is 'Требуется аутентификация'. Below it, the URL 'http://192.168.201.1' and the message 'Подключение к сайту не защищено' are shown. There are two input fields: 'Имя пользователя' with the value 'user' and 'Пароль' with masked characters. At the bottom, there are two buttons: 'Отмена' and 'Войти'.


Открывается окно с текущими настройками дозатора

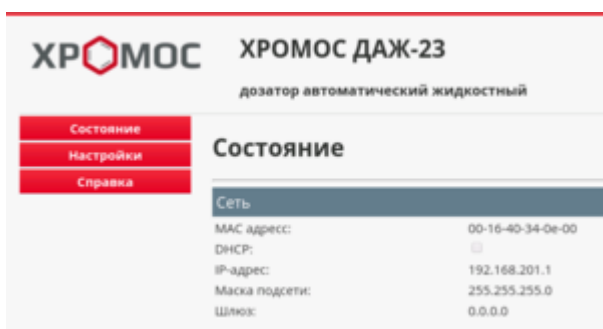


Для изменения настроек необходимо перейти в раздел **Настройки** (красная кнопка слева). После изменения сетевых настроек необходимо нажать кнопку **Сохранить**

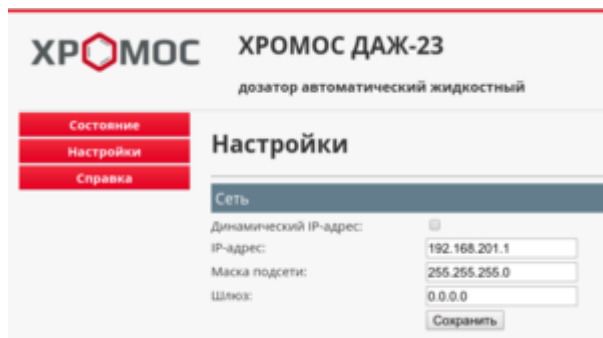

Перезагрузите автосамплер кнопкой **Перезагрузка**

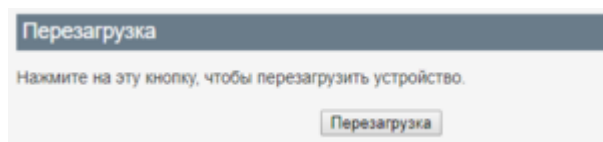

Если вы изменили IP адрес на новый для проверки необходимо ввести в браузер уже новый адрес.

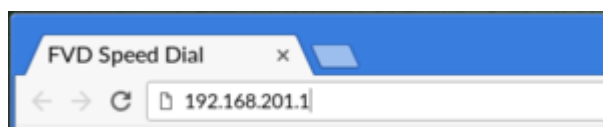

From:
<http://kb.has.ru/> - **База знаний Хромос**

Permanent link:
http://kb.has.ru/dev:dazh23_izmenenie_setevyx_nastroek

Last update: **2021/06/23 13:01**

