

Не задаются параметры у всех модулей

Симптомы


- После нажатия на гайку долго (для сложных приборов очень долго) загружаются параметры перед открытием диалога настроек.
- В программе Хромос оператор задаёт параметры у детекторов, регуляторов расхода и др., но реально они не применяются
- Задания температурных параметров, связанных с блоком управления работает
- В журнале программы Хромос **Chromos.log** после подключения прибора идут строчки с **Таймаут** у подключённых модулей, у блока управления в ответах стоит **OK**
- В диалоге настроек прибора Хромос ГХ-1000, в последней вкладке есть такие строчки «Следующие устройства не отвечают» и перечислены **все** модули, установленные в приборе.

Описание

Ошибка связана с тем, что шлейф связи между блоком управления и остальными модулями выпал в разъёме у блока управления.

Что делать

Вставить шлейф обратно как показано на картинке

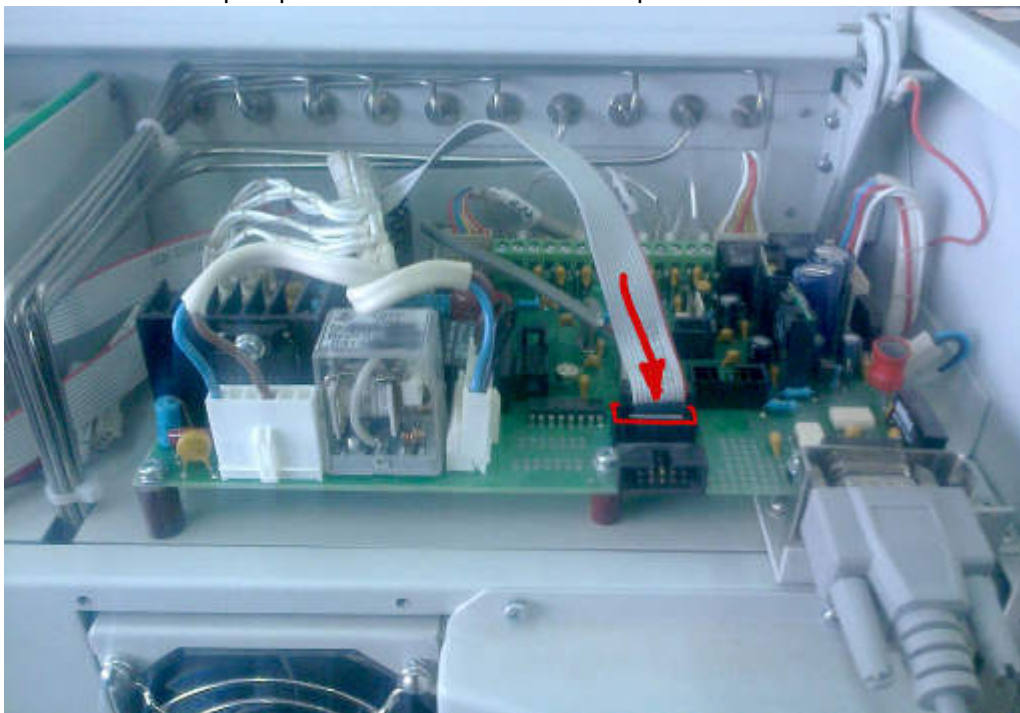

From: <http://kb.has.ru/> - База знаний Хронос

Permanent link: http://kb.has.ru/support/%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%BE%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%88_%D1%83_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%B5%D0%B9

Last update: 2016/06/07 14:22

