

ООО «ХРОМОС Инжиниринг»

Руководство пользователя № ХАС 3.003.013

Программное обеспечение

«Хромос Поток»

ХАС 3.001.002

г. Дзержинск
2025 г.

Содержание

Введение.....	3
1 Подготовка к работе.....	4
1.1 Способы соединения (подключения).....	4
1.2 Запуск ПО «Хромос Поток» через сеть Ethernet.....	4
2 Управление хроматографом.....	6
2.1 Управление по месту.....	6
2.2 Запуск заданий и обработка данных.....	6
3 Описание операций.....	7
3.1 Авторизация.....	7
3.2 Регистрация нового пользователя.....	9
3.3 Просмотр состояния.....	11
3.4 Журналы работы.....	12
3.5 Журнал сообщений об ошибках.....	14
3.6 Журнал вмешательств.....	15
3.7 Настройка расчёта.....	17
3.8 Журнал измерений.....	21
3.9 Градуировочные смеси.....	24
3.10 Журнал градуировки.....	27
3.11 Градуировка хроматографа.....	28
3.12 Средние значения.....	31
3.13 Отчёт.....	32
3.14 Контрольная карта градуировочных коэффициентов.....	33
3.15 Тренды.....	34
4 Настройки.....	35
4.1 Консоль.....	36
4.2 Modbus.....	39
4.3 Настройка автоматизации.....	41
4.4 Планировщик.....	42
4.5 Отчеты.....	44
5 Идентификация программы.....	45
6 Обмен данными.....	46
6.1 Протокол Modbus.....	46
6.2 Протокол Modbus. По умолчанию.....	46
6.3 Протокол Modbus по требованиям СТО Газпром 5.37-2011, СТО Газпром 5.37-2020.....	51
6.4 Настройка карты Modbus.....	64

Введение

Данное руководство пользователя описывает работу со встроенным программным обеспечением «Хромос Поток» (далее ПО), предназначенным для управления хроматографами «Хромос ПГХ-1000», «Хромос ПГХ-1000.1» всех исполнений (далее хроматограф) и обработки хроматографических данных, ведения базы данных по всем анализам.

Метрологически значимая часть встроенного ПО позволяет выполнять проверку приемлемости хроматографических данных и расчёт молярной доли компонентов природного газа по ГОСТ 31371.7-2008, ГОСТ 31371.7-2020, а также расчёт на их основе значений физико-химических показателей природного газа по ГОСТ 31369-2008, ГОСТ 31369-2021, ГОСТ 34704-2020. Также метрологически значимая часть ПО реализует измерение массовой концентрации серосодержащих компонентов по ГОСТ 34723-2021.

Метрологически незначимая часть встроенного ПО позволяет управлять хроматографом и внешними комплектующими, получать, идентифицировать и интерпретировать хроматографическую информацию, настраивать режим работы хроматографа в соответствии с ГОСТ 31371-2008, ГОСТ 31371.7-2020, а также иными методиками выполнения измерений (МВИ), и осуществлять связь с внешними устройствами.

К работе с ПО допускаются лица, изучившие настоящее руководство пользователя, имеющие навыки работы с персональным компьютером и веб-браузерами. Каждый пользователь должен обладать необходимыми знаниями в предметной области для корректной работы с предоставляемой информацией.

1 Подготовка к работе

1.1 Способы соединения (подключения)

Хроматограф имеет каналы связи через последовательный интерфейс RS-485 и по сети Ethernet.


По сети Ethernet поддерживаются протоколы Modbus TCP (порт задаётся в настройках ПО (п. 4.2) и HTTP (порт 80) Web интерфейс, позволяющий удалённо подключаться и управлять хроматографом, считывать данные, формировать отчёты, просматривать и скачивать журналы работы.

По последовательному интерфейсу RS-485 поддерживается соединение по протоколу Modbus RTU, параметры соединения задаются в настройках ПО (п. 4.2).

1.2 Запуск ПО «Хромос Поток» через сеть Ethernet

При работе с ПО «Хромос Поток» через сеть Ethernet на рабочем месте пользователя необходимо выполнить следующие действия:

1. Необходимо запустить веб-браузер (например Google Chrome или любой на основе Chromium, Mozilla Firefox и пр.).
2. В адресной строке браузера указать сетевой адрес хроматографа и нажать переход.
3. В форме аутентификации ввести пользовательский логин и пароль. Нажать кнопку «Войти» (1).

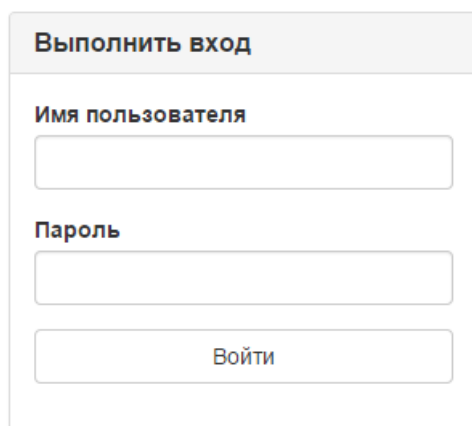

Выполнить вход

Имя пользователя

Пароль

Войти

Рисунок 1 – Выполнить вход

4. Пользователю откроется главная страница ПО «Хромос Поток» (2).

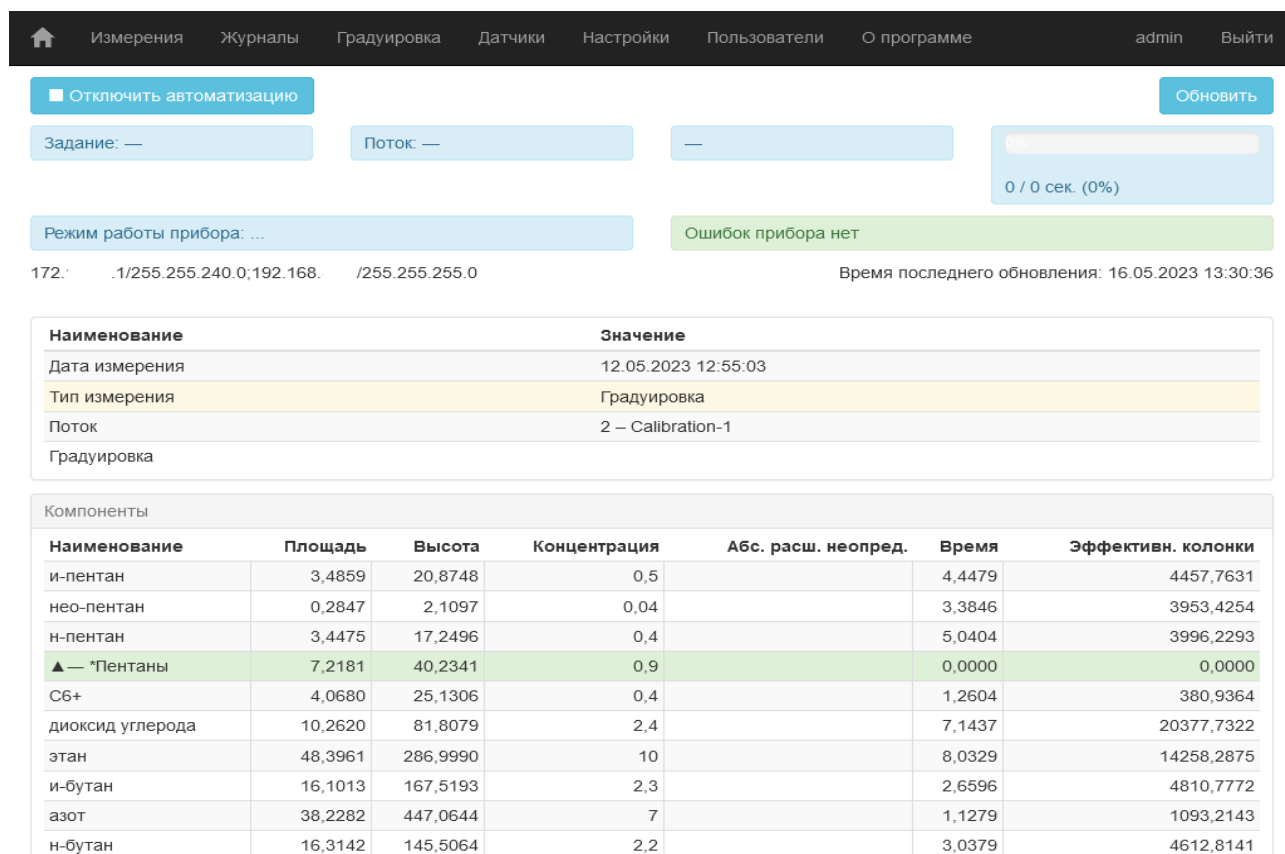


Рисунок 2 – Главная страница ПО «Хромос Поток»

В случае если приложение «Хромос Поток» не запускается, следует обратиться в службу поддержки.

2 Управление хроматографом

2.1 Управление по месту

Для управления хроматографом используется встроенный компьютер с дисплеем, позволяющий пользователю корректировать рабочие параметры в соответствии с условиями конкретного технологического процесса, а также просматривать данные, хранящиеся в приборе.

Управление хроматографом по месту осуществляется при помощи взрывозащищённого манипулятора "Мышь", смонтированного непосредственно на приборе.

Для ввода текстовой информации используется экранная клавиатура, вызываемая нажатием на среднюю кнопку мыши.

2.2 Запуск заданий и обработка данных

Запуск заданий (измерение, градуировка и прочее) осуществляется хроматографом в автоматическом режиме в соответствии с настройками Планировщика, либо вручную оператором через интерфейс ПО. Также возможно удалённое управление запуском заданий путём отправки команд из внешней системы управления.

Условия проведения измерений, температура узлов хроматографа, расход газов-носителей и время переключения кранов задаются на предприятии-изготовителе, содержатся в предустановленных методах и могут быть изменены только по согласованию с предприятием-изготовителем.

Результаты измерений сохраняются на внутреннем носителе встроенного компьютера в реляционной базе данных, отображаются в интерфейсе ПО (в том числе на дисплее прибора) и могут быть переданы во внешнюю систему управления. Также они могут быть выгружены в виде файлов отчётов на съёмные носители пользователем через интерфейс ПО.

ПО для управления хроматографом осуществляет контроль вводимых (вручную или автоматически) значений параметров и блокировку значений, выходящих за установленные границы.


ПО обеспечивает возможность контроля правильности градуировки хроматографа в соответствии с ГОСТ 31371.2-2008, ГОСТ 31371.7-2008, ГОСТ 31371.7-2020, Р Газпром 5.12-2010, ГОСТ Р 53367-2009, ГОСТ 34723-2021.

ПО обеспечивает возможность формирования и передачи параметров и информационных блоков в соответствии с требованиями СТО Газпром 5.37-2020.

3 Описание операций

3.1 Авторизация

Для аутентификации в приложении пользователь должен ввести свое имя пользователя и пароль (3).

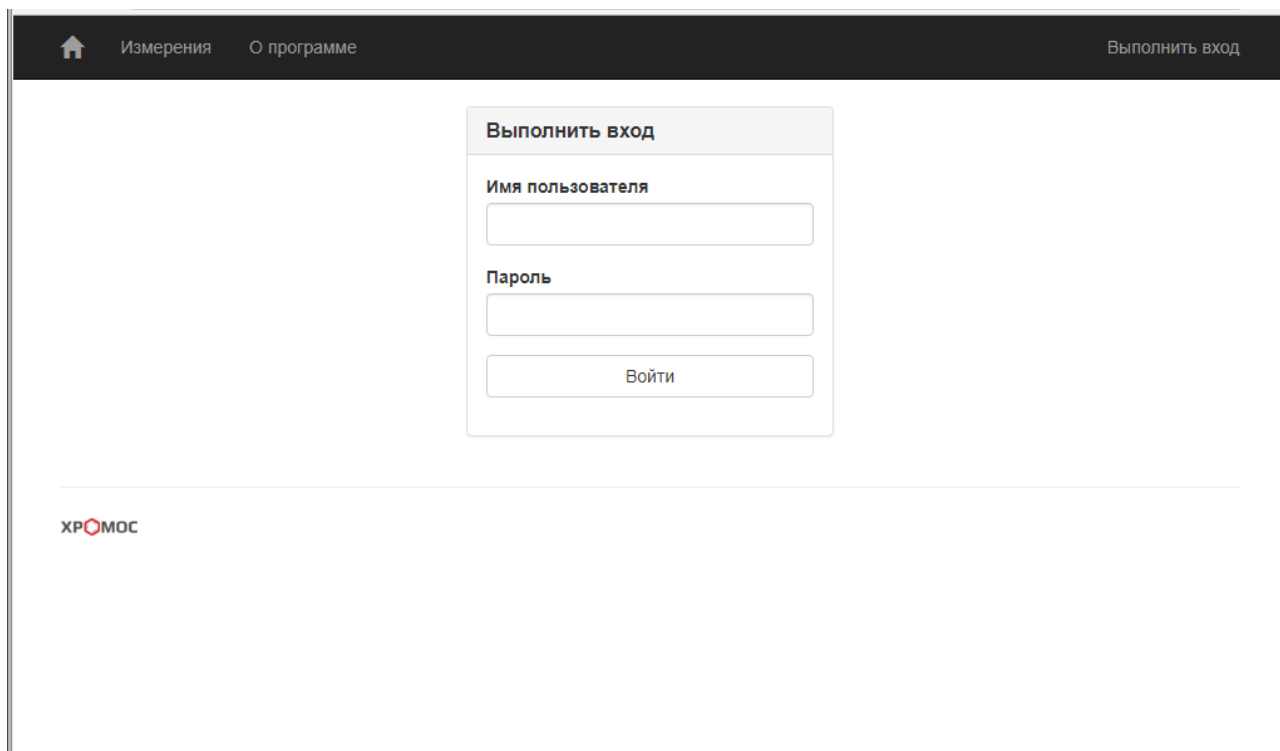

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a dark navigation bar with a home icon, the text 'Измерения', 'О программе', and a 'Выполнить вход' button. The main content area features a light gray box titled 'Выполнить вход'. Inside this box, there are two input fields: 'Имя пользователя' and 'Пароль'. Below the password field is a 'Войти' button. At the bottom left of the main area, the 'ХРОМОС' logo is visible.

Рисунок 3 – Авторизация

По умолчанию установлено:

- логин: admin;
- пароль: password.

Рекомендуется их сменить при первом запуске программы, для этого необходимо авторизоваться и нажать на кнопку с именем пользователя в главном меню. После чего станет доступна форма смены пароля (4). Введите текущий пароль и дважды новый, чтобы исключить ошибку ввода некорректного пароля.

 [Измерения](#) [Архив](#) [Настройки](#) [Пользователи](#) [О программе](#) admin [Выйти](#)

Управление учетной записью

Вы вошли как **admin**.

Форма смены пароля

Текущий пароль

Новый пароль

Подтверждение нового пароля



Рисунок 4 – Форма смены пароля

3.2 Регистрация нового пользователя

Для регистрации нового пользователя перейдите на страницу управления пользователями и доступом. Выберите в главном меню вкладку [Пользователи] (5) → нажмите на кнопку [Создать нового пользователя] (6), затем введите имя пользователя и пароль (пароль должен содержать не менее 6 символов), на следующей странице укажите роль пользователя (7).

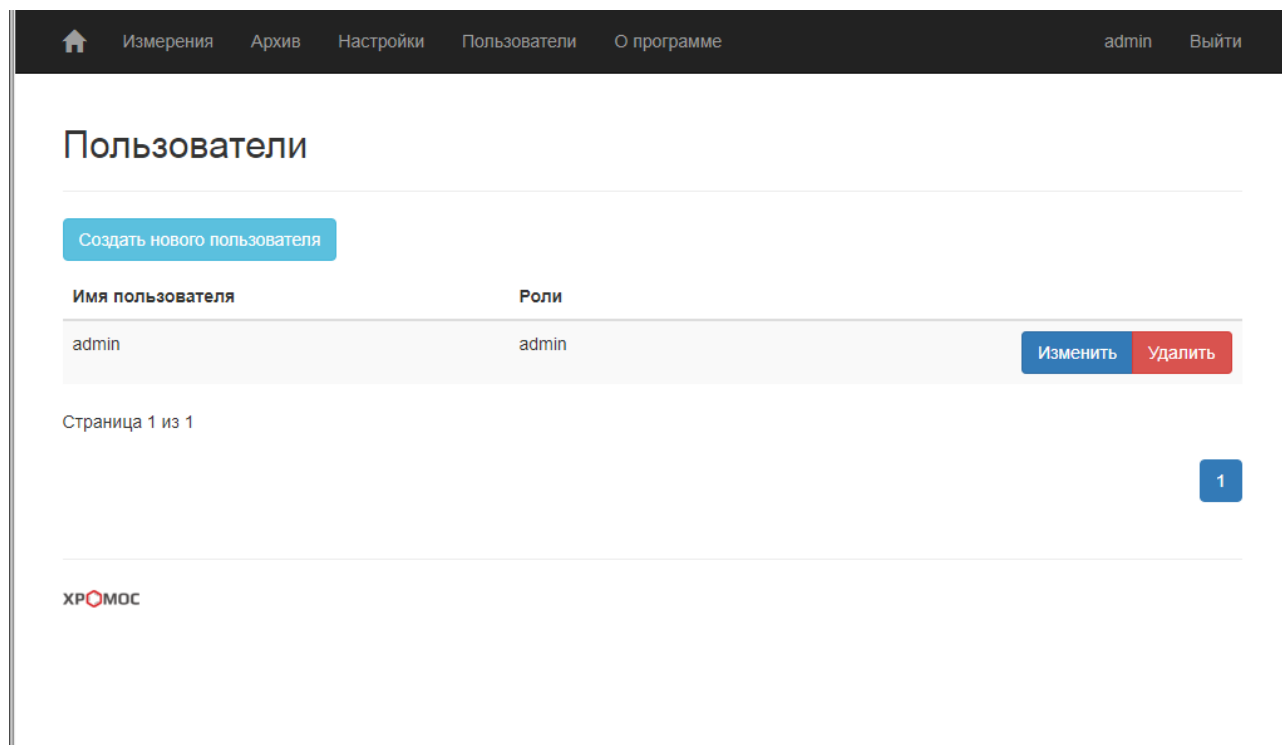


Рисунок 5 – Пользователи

В ПО реализовано три типа ролей «гость», «оператор» и «администратор». Ролью «гость» обладают все неавторизованные пользователи, они имеют право только на просмотр данных в разделах Измерения и Датчики, без права вносить какие-либо изменения. Пользователь с ролью «оператор» может просматривать все журналы и формировать отчёты, но не имеет доступа к настройкам ПО. Пользователь с правами «администратор» имеет возможность просматривать, формировать все отчёты и вносить необходимые изменения в настройки программы, управлять пользователями.

 Измерения

Архив

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Регистрация

Имя пользователя

Пароль

Подтверждение пароля

Регистрация

Отмена



Рисунок 6 – Пользователи. Регистрация

 Измерения

Архив

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Редактировать

Имя пользователя

admin

Роли

admin

Сбросить пароль

Изменить

Сохранить

Удалить

Назад к списку



Рисунок 7 – Пользователи. Редактировать

3.3 Просмотр состояния

На главной странице (8) можно просмотреть состояние хроматографа и последнее измерение. Данные в автоматическом режиме обновляются каждые 15 секунд (настраивается), также можно запросить последние данные нажав на кнопку [Обновить].

ИсмеренияЖурналыГрадуировкаДатчикиНастройкиПользователиО программеadminВыйти

■ Отключить автоматизацию

Обновить

Задание: —

Поток: —

—

0%
0 / 0 сек. (0%)

Режим работы прибора: ...

Ошибка прибора нет

172. .1/255.255.240.0;192.168. /255.255.255.0

Время последнего обновления: 16.05.2023 13:30:36

Наименование	Значение
Дата измерения	12.05.2023 12:55:03
Тип измерения	Градуировка
Поток	2 – Calibration-1
Градуировка	

Компоненты

Наименование	Площадь	Высота	Концентрация	Абс. расш. неопред.	Время	Эффективн. колонки
и-пентан	3,4859	20,8748	0,5		4,4479	4457,7631
нео-пентан	0,2847	2,1097	0,04		3,3846	3953,4254
н-пентан	3,4475	17,2496	0,4		5,0404	3996,2293
▲ — *Пентаны	7,2181	40,2341	0,9		0,0000	0,0000
С6+	4,0680	25,1306	0,4		1,2604	380,9364
диоксид углерода	10,2620	81,8079	2,4		7,1437	20377,7322
этан	48,3961	286,9990	10		8,0329	14258,2875
и-бутан	16,1013	167,5193	2,3		2,6596	4810,7772
азот	38,2282	447,0644	7		1,1279	1093,2143
н-бутан	16,3142	145,5064	2,2		3,0379	4612,8141

Рисунок 8 – Состояние

3.4 Журналы работы

Для просмотра «Журналов работ» выберите в главном меню [Журналы]. Можно просмотреть необходимый журнал работы, выбрав соответствующий пункт в левом меню программы (9).

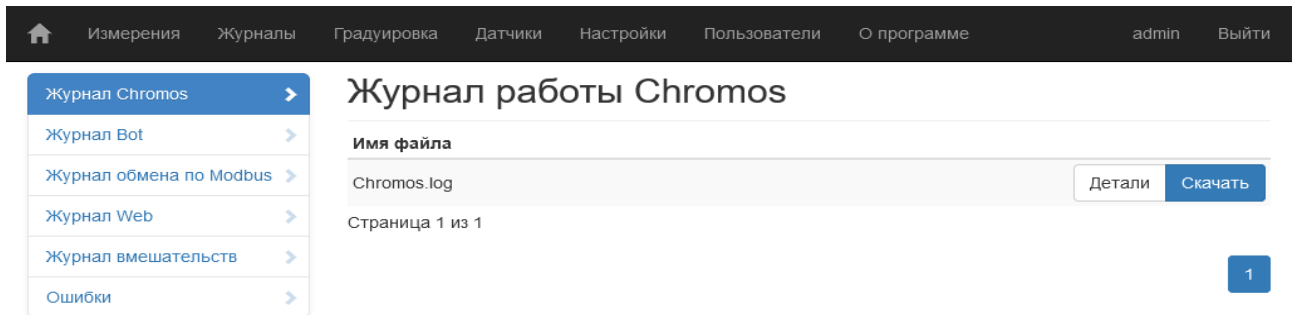


Рисунок 9 – Лог файл

На странице пользователю представлен список журналов (включая архивные) выбранного приложения.

- «Имя файла» – имя файла журнала;
- «Детали» – просмотр файла;
- «Скачать» – сохранение файла .

Выбрав [Детали] можно увидеть информацию по журналу и просмотреть этот файл, а также сохранить его в виде текстового файла (10).

🏠

Измерения

Журналы

Градуировка

Датчики

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Журнал Chromos

Журнал Bot

Журнал обмена по Modbus

Журнал датчиков

Журнал Web

Журнал вмешательств

Ошибки

Детали

Назад

Скачать

Полное имя файла

/Chromos/Chromos.log

Имя файла

Chromos.log

Просмотр

10/04/2024 09:32:47 прибор 1: Загрузка: БУ: стек 0 0

10/04/2024 09:32:47 t Прибор 1: Текущие значения: ТЕМПЕРАТУРЫ { Зона 0=0.00/-39.79/150.00 Зона

10/04/2024 09:32:47 - Прибор 1: Подготовка температур и газов

10/04/2024 09:32:47 ^ Биты неготовности: 02000000 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 1 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 2 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 3 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 4 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 5 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 6 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 7 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 8 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:47 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 9 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 10 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 11 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 12 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 13 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 14 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: стек 15 0 Зачитан ОК 0x00000000

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Загрузка: БУ: Тип прибора 0 Зачитан ОК 0x

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Чтение: БУ: Модификатор 0x00002000 Зачитан ОК 0x0

10/04/2024 09:32:48 Прибор 1: Чтение: БУ: Версия прошивки 0x1913 Зачитан ОК 0x0

ХРОМОС

Рисунок 10 – Лог файл. Детали

3.5 Журнал сообщений об ошибках

Для просмотра журнала сообщений об ошибках необходимо выбрать [Журналы] → [Ошибки] (11). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Дата» – дата возникновения ошибки;
- «Тип» – тип ошибки;
- «Код» – код ошибки;
- «Сообщение» – описание ошибки.

 Измерения Журналы Градуировка Датчики Настройки Пользователи О программе admin Выйти	
Журнал Chromos >	Ошибки
Журнал Bot >	
Журнал обмена по Modbus >	
Журнал Web >	
Журнал вмешательств >	
Ошибки >	

Дата	Тип	Код	Сообщение
17.04.2023 4:59:40	Автоматизация	100	Некорректное измерение
17.04.2023 4:58:01	Автоматизация	103	Полученное при выполнении измерения количество файлов хроматограмм меньше числа каналов
14.04.2023 8:31:15	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
14.04.2023 8:25:08	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
14.04.2023 8:17:14	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
14.04.2023 8:07:55	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
17.03.2023 10:25:53	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
16.03.2023 14:25:48	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
16.03.2023 14:18:17	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
16.03.2023 12:28:13	Автоматизация	103	Полученное при выполнении измерения количество файлов хроматограмм меньше числа каналов
06.03.2023 14:35:03	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
06.03.2023 14:09:56	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
06.03.2023 14:09:09	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
06.03.2023 14:08:06	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
06.03.2023 14:06:36	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
06.03.2023 14:00:18	Автоматизация	102	Ошибка запроса внешних параметров при выполнении измерения
27.02.2023 10:02:45	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы
27.02.2023 10:00:50	Автоматизация	3	Аварийное завершение работы

Рисунок 11 – Ошибки

3.6 Журнал вмешательств

Для просмотра журнала вмешательств необходимо выбрать [Журналы] → [Журнал вмешательств] (12). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Дата вмешательства» – дата осуществления вмешательства;
- «Код вмешательства» – описание произведённого вмешательства;
- «Предыдущее значение» – значение до вмешательства, прочерк означает что объекта вмешательства ранее не существовало;
- «Новое значение» – значение после вмешательства, прочерк означает что объект вмешательства был удалён.

Журнал Chromos

Журнал Bot

Журнал обмена по Modbus

Журнал датчиков

Журнал Web

Журнал вмешательств

Ошибки

Журнал вмешательств

от 28.05.2024 0:00:00

до 28.05.2025 8:21:51

Код вмешательства 0 Все

Ввод

Дата вмешательства	Код вмешательства	Предыдущее значение	Новое значение	
28.05.2025 8:19:39	916 Bot.Добавление привязки метода к каналу и потоку	—	<Объект>	Детали
28.05.2025 8:19:29	916 Bot.Добавление привязки метода к каналу и потоку	—	<Объект>	Детали
28.05.2025 8:19:16	201 Запуск.Автоматизация	Да	Нет	Детали
28.05.2025 8:19:10	201 Запуск.Автоматизация	Нет	Да	Детали
25.03.2025 10:42:51	919 Bot.Добавление датчика	—	<Объект>	Детали
19.02.2025 16:02:23	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:02:14	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:02:09	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:02:02	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:01:57	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:01:51	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали
19.02.2025 16:01:44	921 Bot.Удаление датчика	<Объект>	—	Детали

Страница 1 из 1

1

Рисунок 12 – Вмешательства

Для комплексных параметров (задания Планировщика, привязки методов, датчики, группы компонентов и т. д.) в полях значений отображается <Объект>. Для просмотра подробной информации о вмешательстве необходимо нажать кнопку [Детали] рядом с вмешательством.

Откроется страница с данными (13)

Измерения

Журналы

Градуировка

Датчики

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Журнал Chromos

Журнал Bot

Журнал обмена по Modbus

Журнал датчиков

Журнал Web

Журнал вмешательств

Ошибки

Вмешательство

Назад

☐ Показывать только изменения

Экспорт

Печать

Наименование	Значение
Дата вмешательства	28.05.2025 8:31:39
Имя пользователя	admin (::1)
Код вмешательства	920 Bot.Изменение датчика

Предыдущее значение

Наименование	Значение
Имя	Modbus TCP
Имя в карте Modbus	
Опрос	☐
Тип	Modbus TCP
Единица измерения	
Период нечувствительности (сек.)	0
Тип рабочего диапазона	- Отсутствует -
Slave Id	1
TCP хост	127.0.0.1
TCP порт	502
Таймаут чтения	500
Таймаут записи	500
Адрес	0
Тип параметра	UInt16

Рисунок 13 – Детали вмешательства

Изменившиеся параметры выделены красным. В поле имени пользователя указан также сетевой адрес, с которого было произведено вмешательство. При изменении параметра через локальный интерфейс прибора отображается «(::1)»

Для удобства отображения можно установить флажок [Показывать только изменения], в этом случае отображатся только изменившиеся параметры объекта (14)

Измерения

Журналы

Градуировка

Датчики

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Журнал Chromos

Журнал Bot

Журнал обмена по Modbus

Журнал датчиков

Журнал Web

Журнал вмешательств

Ошибки

Вмешательство

Назад

☒ Показывать только изменения

Экспорт

Печать

Наименование	Значение
Дата вмешательства	28.05.2025 8:31:39
Имя пользователя	admin (::1)
Код вмешательства	920 Bot.Изменение датчика

Предыдущее значение

Наименование	Значение
Адрес	0
Тип регистра	InputRegister

Новое значение

Наименование	Значение
Адрес	2
Тип регистра	HoldingRegister

Рисунок 14 – Детали вмешательства – только изменившиеся параметры

3.7 Настройка расчёта

ПО «Хромос Поток» позволяет учитывать молярную долю компонентов, не определяемых с помощью хроматографа и принятых как условно-постоянные. Количество условно-постоянных компонентов не ограничено.

Для того чтобы указать условно-постоянные компоненты, участвующие в расчёте, выберите [Настройки] → [Расчёт] (15). Пользователю будет представлена таблица «Компоненты» содержащая следующая информация:

- «Внешний компонент» – наименование условно-постоянного компонента. В качестве условно-постоянного компонента может быть выбран любой из компонентов;
- «Концентрация (мол, %))» – молярная доля внешнего компонента выраженная в процентах.

Настройка расчёта

Метан по разности ☒

Температура сгорания

Температура измерения

Расчетное время

Корректировка по атмосферному давлению ☐

Нормализация ☐

Фильтрация анализов (%)

Градуировка одна для всех потоков ☒

Игнорировать отсутствие в анализе компонентов градуировочной смеси ☒

Сохранить

Компоненты	
<button>Добавить компонент</button>	
Внешний компонент	Концентрация (мол %)
гелий	0,00224
<button>Изменить</button> <button>Удалить</button>	

Рисунок 15 – Расчёт

Для добавления условно-постоянного компонента необходимо выбрать [Добавить компонент] и на открывшейся странице (16) указать наименование компонента из выпадающего списка и его концентрацию в молярной доли выраженной в процентах.

The screenshot shows the 'Добавить внешний компонент' (Add external component) form in the XROMOS software interface. The top navigation bar includes a home icon, 'Измерения' (Measurements), 'Архив' (Archive), 'Настройки' (Settings), 'Пользователи' (Users), 'О программе' (About the program), 'admin', and 'Выйти' (Logout). The left sidebar contains a menu with 'Общие' (General), 'Консоль' (Console), 'Modbus', 'Расчет' (Calculation), 'Запуск' (Start), 'Градуировочные смеси' (Calibration mixtures), 'Журналы работы' (Work logs), 'Планировщик' (Scheduler), and 'Отчеты' (Reports). The main form area has the title 'Добавить внешний компонент'. It contains two input fields: 'Внешний компонент' (External component) with a dropdown menu showing 'этан' (ethane), and 'Концентрация (мол %)' (Concentration (mol %)) with a text input showing '0' and up/down arrow buttons. Below the concentration input is a note: 'концентрация компонента указывается в молярных процентах' (component concentration is indicated in molar percentages). At the bottom of the form are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Сохранить' (Save). The XROMOS logo is visible in the bottom left corner of the main content area.

Рисунок 16 – Расчёт. Добавить внешний компонент

Для изменения концентрации условно-постоянного компонента необходимо напротив него выбрать [Изменить] (17) и на открывшийся странице (18) указать новую концентрацию в молярной долях выраженной в процентах.

Для удаления условно-постоянного компонента необходимо напротив него выбрать [Удалить] (17) и на открывшийся странице (19) подтвердить действие.

Запуск

Градуировочные смеси

Журналы работы

Планировщик

Отчеты

температура сгорания

20 °C

Температура измерения

20°C

Расчетное время

00:00:00

Корректировка по атмосферному давлению

Сохранить

Компоненты

Добавить компонент

Внешний компонент	Концентрация (мол %)	
вода	0,8	Изменить Удалить

ХРОМОС

Рисунок 17 – Расчёт. Компоненты

Измерения

Архив

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Общие

Консоль

Modbus

Расчет

Запуск

Градуировочные смеси

Журналы работы

Планировщик

Отчеты

Изменить внешний компонент

Концентрация (мол %)

0,8

концентрация компонента указывается в молярных процентах

Сохранить

Отмена

ХРОМОС

Рисунок 18 – Расчёт. Изменить внешний компонент

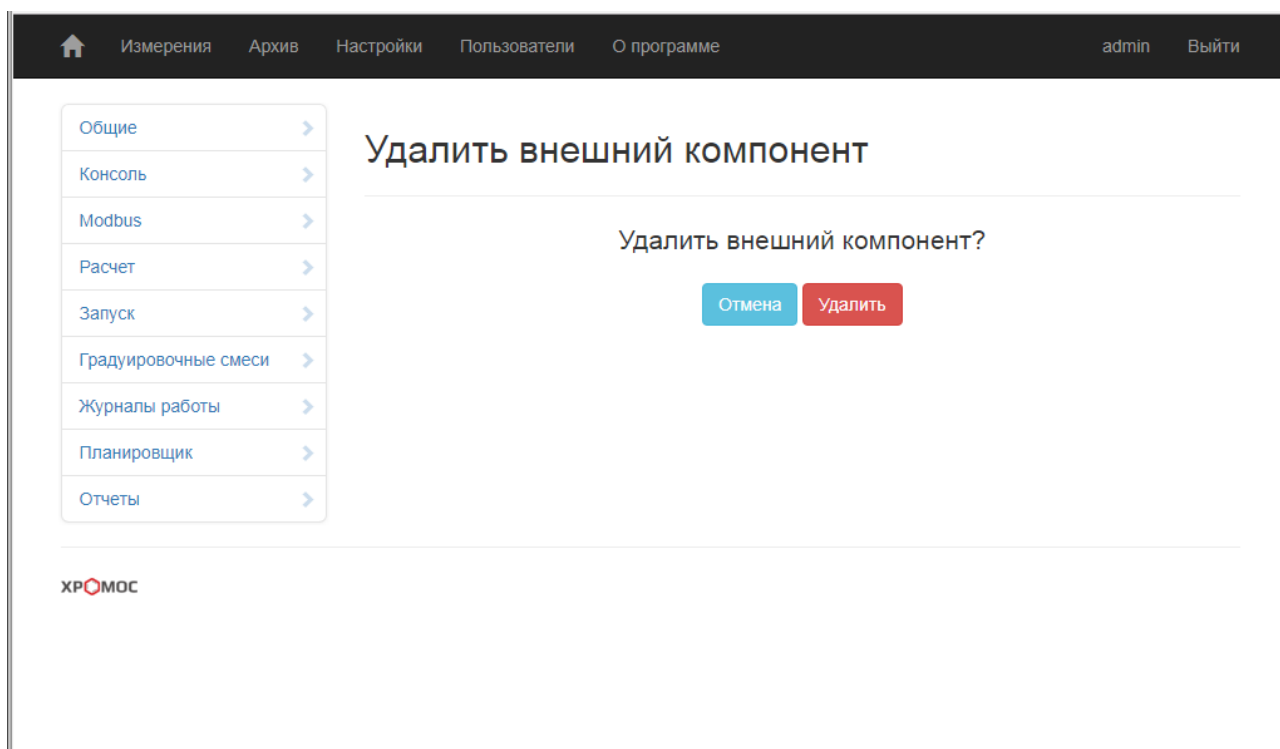


Рисунок 19 – Расчет. Удалить внешний компонент

Молярная доля условно-постоянных компонентов устанавливается равная значениям указанным в настройках расчёта.

Чтобы выбрать метод расчёта метана необходимо поставить галочку напротив пункта «Метан по разности» для расчёта по разности или снять для расчёта по анализу (15).

Стандартные температуры сгорания и измерения выбираются из выпадающих списков дискретных значений. Стандартная температура сгорания может быть задана значением: 0, 15, 15.55, 20 и 25 °С. Стандартная температура измерения может быть задана значением: 0, 15, 15.55, и 20 °С.

Для корректировки концентраций компонентов по атмосферному давлению необходимо поставить галочку напротив пункта «Корректировка по атмосферному давлению».

3.8 Журнал измерений

Для просмотра журнала измерений необходимо выбрать [Измерения] в главном меню (20). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Дата измерения» – дата создания измерения;
- «Тип измерения» – возможные значения «Измерение», «Градуировка», «Ручной», «Некорректное».

Для экспорта результатов измерений в формате CSV необходимо нажать кнопку «Экспорт». В экспортируемый файл будут записаны все измерения за выбранный период, но не более 1000 записей.

The screenshot shows the 'Измерения' (Measurements) page. The sidebar on the left contains the following items: 'Измерения', 'Градуировки', 'Контроль градуировок', 'Средние значения', 'Отчет', 'Контрольные карты градуир. коэфф.', 'Тренды', and 'Тренды по параметрам'. The main header area includes filters for 'от' (from) 10.06.2025 0:00:00, 'до' (to) 05.07.2025 8:06:54, and 'Поток' (Stream) 1 – Анализ. A 'Ввод' (Input) button is also present. The table below displays the measurement data:

Дата измерения	Тип измерения	Поток	
04.07.2025 9:17:59	Измерение	1 – Анализ	Детали
11.06.2025 9:21:59	Градуировка	1 – Анализ	Детали
11.06.2025 9:21:38	Градуировка	1 – Анализ	Детали
11.06.2025 9:21:17	Градуировка	1 – Анализ	Детали
11.06.2025 9:18:32	Измерение	1 – Анализ	Детали
11.06.2025 9:17:16	Некорректное	1 – Анализ	Детали

Below the table, it says 'Страница 1 из 1'. At the bottom right, there is a '1' button and an 'Экспорт' (Export) button.

Рисунок 20 – Измерения

Для просмотра подробной информации о хроматограмме выберите [Детали] на нужной записи в перечне измерений. На открывшейся странице пользователю будет представлена следующая информация (21):

- «Дата измерения» – дата проведения измерений;
- «Тип измерения» – возможные значения «Измерение», «Градуировка», «Ручной», «Некорректное»;
- «Градуировка» – ссылка на градуировку;
- «Атмосферное давление» – атмосферное давление в момент начала анализа;
- Физико-химические свойства анализа и их абсолютная расширенная неопределённость (22):
 - «Наименование»;
 - «Значение»;
 - «Абс. расш. неопред.» – абсолютная расширенная неопределённость;

- Список компонентов (23):
 - «Наименование» – наименование компонента;
 - «Площадь» – площадь пика;
 - «Высота» – высота пика;
 - «Концентрация» – концентрация компонента;
 - «Ед. изм.» – единица измерения компонента;
 - «Абс. расш. неопред.» – абсолютная расширенная неопределённость результата измерения компонента;
 - «Время» – время выхода компонента;
 - «Эффективн. колонки».

Наименование	Значение
Дата измерения	04.07.2025 9:17:59
Тип измерения	Измерение
Поток	1 – Анализ
Градуировка	Детали
Атмосферное давление	98,0664978027344

Рисунок 21 – Измерения. Детали

Физико-химические свойства		
Наименование	Значение	Абс. расш. неопред.
Атмосферное давление	101,3250	
Температура сгорания	25°C	
Плотность реального газа (кг/м3)	0,9879	0,0067
Плотность идеального газа (кг/м3)	0,9844	0,0000
Относительная плотность реального газа	0,8201	0,0055
Относительная плотность идеального газа	0,8175	0,0000
Высшая теплота сгорания массовая (МДж/кг)	42,6956	0,3589
Высшая теплота сгорания массовая (ккал/кг)	10197,6714	85,7236
Низшая теплота сгорания массовая (МДж/кг)	38,8023	0,3254
Низшая теплота сгорания массовая (ккал/кг)	9267,7622	77,7110
Высшая теплота сгорания молярная (кДж/моль)	1011,0329	6,8327
Высшая теплота сгорания молярная (кал/моль)	241481,0681	1631,9572
Низшая теплота сгорания молярная (кДж/моль)	918,8385	6,3045
Низшая теплота сгорания молярная (кал/моль)	219460,7978	1505,8039
Высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м3) реального газа	42,1777	0,2864
Высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м3) идеального газа	42,0299	6,7498

Рисунок 22 – Измерения. Детали (Физико-химические свойства анализа)

Компоненты							
Наименование	Площадь	Высота	Концентрация	Ед. изм.	Абс. расш. неопред.	Время	Эффективн. колонки
С6+	12,5548	155,4978	0,5104	%мол	0,0520	1,2004	1388,8945
диоксид углерода	56,2712	369,8633	6,1002	%мол	0,3672	8,0871	17753,0871
этан	93,4497	449,1139	6,7943	%мол	0,2731	9,0137	11790,9366
и-пентан	19,8782	111,8273	0,8999	%мол	0,0552	5,2579	5497,2899
и-бутан	35,8604	319,3937	2,3009	%мол	0,1393	3,1329	4892,1377
метан	0,0000	0,0000	70,2275	%мол	0,5941	0,0000	0,0000
нео-пентан	0,3578	3,1090	0,0170	%мол	0,0022	3,9796	7512,2860
азот	81,4452	747,4965	6,3015	%мол	0,2534	1,8354	1782,9406
н-бутан	36,1550	284,1368	2,2005	%мол	0,1332	3,5954	5016,4434
н-пентан	20,1147	99,9470	0,9101	%мол	0,0558	5,9779	5543,6098
кислород	10,4911	132,8895	0,8399	%мол	0,0516	1,5104	2299,9319
пропан	47,5593	502,3223	2,8977	%мол	0,1751	2,4729	4286,4010

Рисунок 23 – Измерения. Детали (Список компонентов)

ПО автоматически рассчитывает значения расширенной неопределённости результатов измерений молярной доли компонентов в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008, ГОСТ 31371.7-2020, ГОСТ 34723-2021 (23). Значения отражаются в графе "Абсолютная расширенная неопределённость" таблицы компонентов.

Значения расширенной неопределённости ФХП природного газа, рассчитываемого в соответствии с ГОСТ 31369-2008, ГОСТ 31369-2021, ГОСТ 34723-2021 отражаются в графе "Абсолютная расширенная неопределённость" таблицы физико-химических показателей (22).

ПО автоматически рассчитывает значение относительного отклонения молярной доли компонентов в градуировочной смеси от измеренного значения молярной доли компонентов в анализируемом газе и сравнивает полученную величину с предельно допустимым значением, указанным в ГОСТ 31371.2-2008, ГОСТ 31371.7-2020. При превышении норматива ПО выдаёт предупреждение «Градуировочная смесь не соответствует анализируемому газу» (24).

Градуировочная смесь не соответствует анализируемому газу.

Рисунок 24 – Предупреждение. Градуировочная смесь не соответствует анализируемому газу.

Для экспорта результата измерения в формате PDF необходимо нажать кнопку «Экспорт». Для печати результата измерения необходимо нажать кнопку «Печать». В системе должен быть установлен принтер для выполнения данного действия.

3.9 Градуировочные смеси

Для ввода и изменения записей о градуировочных смесях выберите [Настройки] → [Градуировочные смеси] (25).

Пользователю будет представлен список градуировочных смесей. Смесь, используемая для автоматической градуировки хроматографа, будет выделена зелёным цветом. Здесь можно удалить выбранную смесь, отредактировать или создать новую.

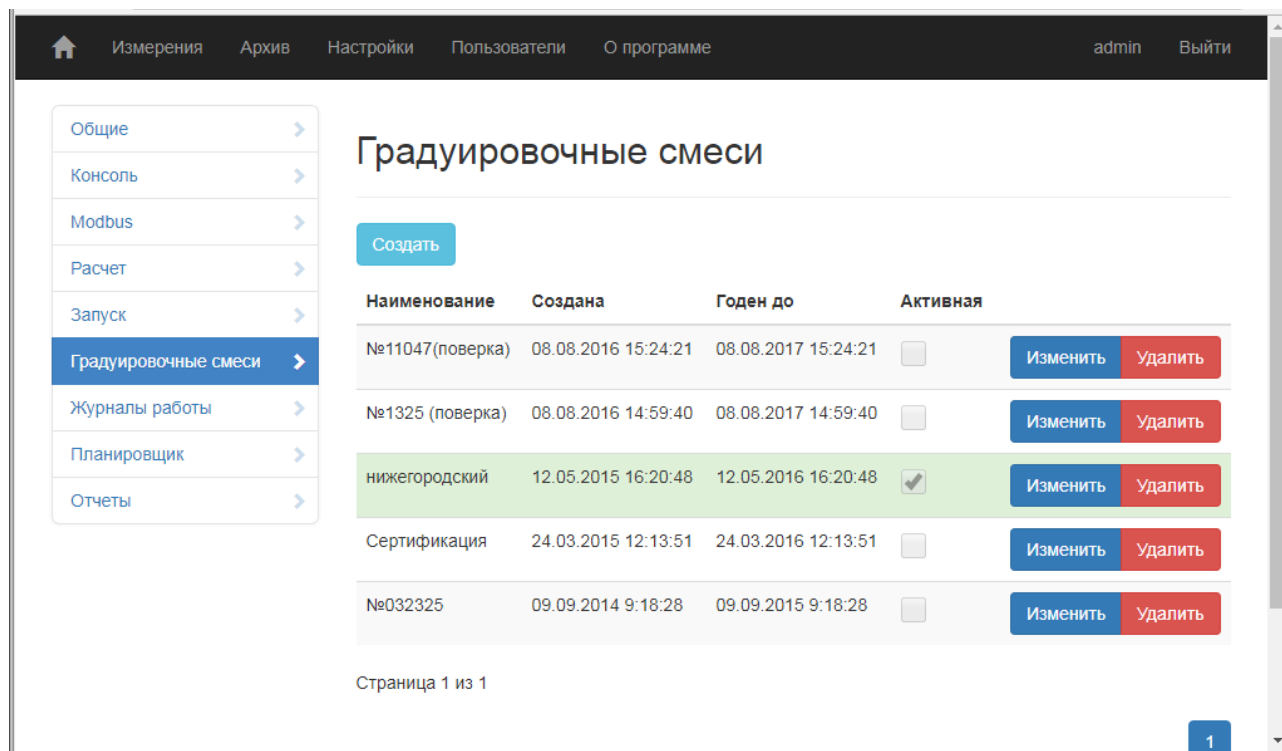


Рисунок 25 – Список градуировочных смесей

Нажмите на кнопку [Создать], чтобы добавить новую смесь. Укажите наименование градуировочной смеси (26) и нажмите кнопку [Сохранить]. В результате будет представлена страница с описанием градуировочной смеси (27).

- «Наименование» – наименование градуировочной смеси;
- «Создана» – дата создания записи;
- «Годен до» – необходимо указать срок годности градуировочной смеси;
- «Активная» – флаг указывает используется ли эта смесь при градуировке хроматографа;
- «Компоненты» – список компонентов и их концентрации присутствующие в смеси:
 - «Наименование» – наименование компонента;
 - «Концентрация» – концентрация компонента (в молярных процентах).

Чтобы изменить или отредактировать описание градуировочной смеси перейдите на страницу с описанием градуировочной смеси (27). Редактировать и удалять смеси, которые были использованы в любых расчётах, невозможно.

The screenshot shows the 'Создать градуировочную смесь' (Create calibration mixture) form. The left sidebar contains a menu with items: Общие, Консоль, Modbus, Расчет, Запуск, Градуировочные смеси, Журналы работы, Планировщик, and Отчеты. The main area has a title 'Создать градуировочную смесь'. Below the title is a form with a label 'Наименование' and an empty text input field. To the left of the input field is a blue button labeled 'Отмена'. To the right of the input field is a button labeled 'Сохранить'. At the bottom left of the main area is the XROMOS logo.

Рисунок 26 – Создать градуировочную смесь

The screenshot shows the 'Градуировочная смесь' (Calibration mixture) form. The left sidebar is the same as in Figure 26. The main area has a title 'Градуировочная смесь'. Below the title is a form with the following fields: 'Наименование' (№032325), 'Создана' (09.09.2014 9:18:28), 'Годен до' (09.09.2015 9:18:28), and 'Активная' (checkbox). To the right of the 'Активная' checkbox are buttons 'Сохранить' and 'Удалить'. Below these fields is a section titled 'Компоненты'. It contains a blue button 'Добавить компонент' and a table with two columns: 'Наименование' and 'Концентрация'. The table has one row with 'пропан' and '0,9'. To the right of the table are buttons 'Изменить' and 'Удалить'.

Рисунок 27 – Градуировочная смесь

Для добавления компонента в градуировочную смесь нажмите на кнопку [Добавить компонент] (27). Выберите наименование компонента из выпадающего списка и укажите содержание компонента в молярных процентах (28).

 Измерения

 Архив

 Настройки

 Пользователи

 О программе

admin

Выйти

Общие

Консоль

Modbus

Расчет

Запуск

Градуировочные смеси

Журналы работы

Планировщик

Отчеты

Добавить компонент

Компонент

Концентрация

0

▲▼

концентрация компонента указывается в молярных процентах

Сохранить

Отмена

ХРОМОС

Рисунок 28 – Добавить компонент

3.10 Журнал градуировки

Для просмотра журнала градуировок выберите [Измерения] в главном меню → [Градуировки] (29). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Дата создания» – дата, когда были рассчитаны градуировочные коэффициенты;
- «Поток» – поток градуировки;
- «Первичная» – базовая градуировка для построения контрольной карты (3.14);
- «Успешно» – флаг, свидетельствующий о статусе операции;
- «Активная» – применяется для расчёта концентраций;
- «Вид зависимости» – используемая методика либо формула для расчёта коэффициентов.

Градуировки

от 10.06.2023 0:00:00 до 14.12.2023 18:40:48 Поток По всем

Первичная Все Успешно Все Активная Все Ввод

Дата создания	Поток	Первичная	Успешно	Активная	Вид зависимости	
14.12.2023 18:39:52	1 – Анализ	☐	☒	☐	$Y = k1 \cdot X$ (Классический метод)	Детали
29.11.2023 11:33:41	2 – Градуировка	☐	☒	☐	ГОСТ 31371.7-2020 (Метод Б)	Детали
25.11.2023 11:57:53	2 – Градуировка	☐	☒	☐	ГОСТ 34723-2021 (нелинейная)	Детали
21.11.2023 8:50:52	1 – Анализ	☐	☒	☐	ГОСТ 31371.7-2008	Детали
21.11.2023 8:49:29	1 – Анализ	☐	☐	☐	ГОСТ 31371.7-2008	Детали
21.11.2023 8:49:21	1 – Анализ	☐	☐	☐	ГОСТ 31371.7-2008	Детали
21.11.2023 8:49:13	1 – Анализ	☐	☐	☐	ГОСТ 31371.7-2008	Детали
20.11.2023 15:16:10	1 – Анализ	☐	☒	☐	ГОСТ 31371.7-2020 (Метод Б)	Детали

Рисунок 29 – Градуировки

3.11 Градуировка хроматографа

Градуировка потокового хроматографа осуществляется автоматически в соответствии с настройками планировщика (п.4.4). Установление программным обеспечением градуировочных коэффициентов возможно только с помощью градуировочных хроматограмм.

В автоматическом режиме происходит переключение с рабочего потока на градуировочный поток (потоки), и регистрируются градуировочные хроматограммы, после чего ПО проводит вычисление градуировочных коэффициентов. По окончании градуировки происходит смена потока на рабочий.

ПО «Хромос Поток» проводит расчёт значений градуировочных коэффициентов для всех компонентов при каждом вводе градуировочной смеси и по окончании градуировки рассчитывает итоговые градуировочные коэффициенты в соответствии с методикой.

В случае несоответствия условиям приемлемости градуировки по любому из компонентов ПО генерирует предупреждение (30), в итоговом отчёте градуировки указывается ошибка и для дальнейшего расчёта ПО принимает градуировочные коэффициенты, полученные при последней градуировке, удовлетворяющей требованиям приемлемости.

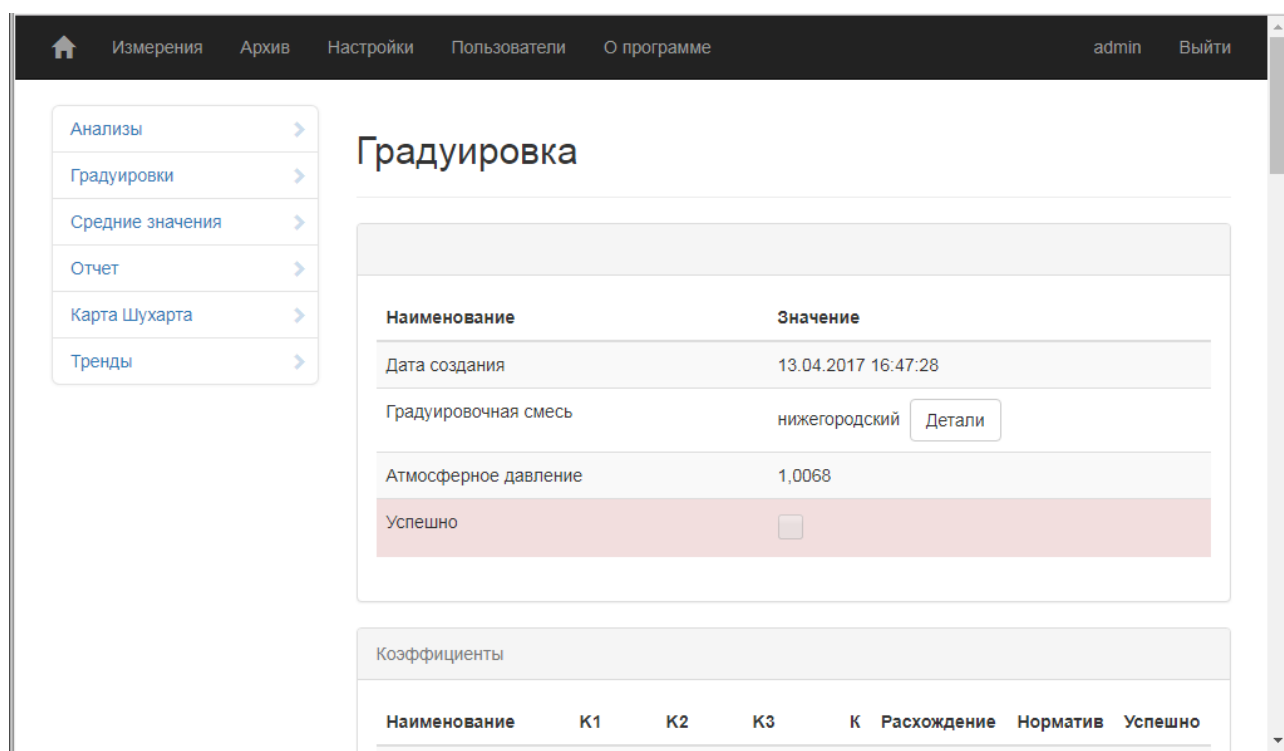


Рисунок 30 – Градуировки. Детали (Ошибочная)

Для просмотра детальных сведений по выбранной градуировке выберите [Детали] в журнале градуировок (29). Пользователю будет представлена следующая информация (31):

- «Дата создания» – дата, когда были вычислены градуировочные коэффициенты;
- «Градуировочная смесь» – наименование градуировочного баллона и ссылка для его открытия;
- «Атмосферное давление» – атмосферное давление в момент начала градуировки;
- «Поток» – поток градуировки;
- «Успешно» – флаг, свидетельствующий о статусе операции;

- «Первичная» – базовая градуировка для построения контрольной карты (3.14);
- «Активная» – применяется для расчёта концентраций;
- «Вид зависимости» – используемая методика либо формула для расчёта коэффициентов
- «Коэффициенты» – список градуировочных коэффициентов:
 - «Наименование» – наименование компонента;
 - «K1» – значение градуировочного коэффициента полученное из 1 хроматограммы;
 - «K2» – значение градуировочного коэффициента полученное из 2 хроматограммы;
 - «K3» – значение градуировочного коэффициента полученное из 3 хроматограммы;
 - «K» – среднее арифметическое значение градуировочных коэффициентов, полученное из трёх градуировочных хроматограмм;
 - «Расхождение» – отклонение;
 - «Норматив» – допускаемое отклонение;
 - «Успешно» – флаг, свидетельствующий о статусе операции.

Состав данной таблицы может изменяться в соответствии выбранным с видом зависимости и методики выполнения измерений.

- «Хроматограмма» – градуировочные хроматограммы по которым проводили вычисление градуировочных коэффициентов (32).

Исследования

Журналы

Градуировка

Датчики

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Исследования

Градуировки

Контроль градуировок

Средние значения

Отчет

Контрольные карты градуир. коэфф.

Тренды

Тренды по параметрам

Градуировка

Назад

Экспорт

Печать

Наименование

Значение

Дата создания

04.07.2025 9:16:20

Градуировочная смесь

Баллон ГСО1

Детали

Поток

3 – Тест

Успешно

☒

Первичная

☐

Выбрать первичной

Активная

☒

Вид зависимости

ГОСТ 31371.7-2020 (Метод Б)

Коэффициенты

Компонент	K1	K2	K3	K	Расхождение	Норм.	Успешно
азот	0,0773	0,0774	0,0775	0,0774	0,2841	3,2165	☒
диоксид углерода	0,1084	0,1085	0,1084	0,1084	0,0919	4,8157	☒
и-бутан	0,0641	0,0642	0,0642	0,0642	0,2392	4,8417	☒
и-пентан	0,0452	0,0453	0,0453	0,0453	0,1029	4,9067	☒

Рисунок 31 – Градуировки. Детали

Хроматограмма 1 – [Баллон ГСО1] – 04.07.2025 9:15:38

Наименование	Площадь	Высота
С6+	12,5386	154,9448
диоксид углерода	56,2946	370,3898
этан	93,5512	450,0309
и-пентан	19,8929	111,8142
и-бутан	35,8960	319,5478
нео-пентан	0,3576	3,1068
азот	81,5450	747,8910
н-бутан	36,1921	284,2047
н-пентан	20,1175	99,8771
кислород	10,5044	132,9887
пропан	47,6779	502,7316

Рисунок 32 – Градуировки. Детали (Градуировочные хроматограммы)

3.12 Средние значения

Для просмотра средних арифметических значений результата определения ФХП, выберите в главном меню программы [Измерения] → [Средние значения] и укажите период измерений (33). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Текущий час» – с начала текущего часа и до текущего момента времени;
- «Текущие сутки» – с начала суток (с учётом расчётного часа) до текущего момента времени;
- «Последний закрытый час» – с начала и до конца последнего истёкшего часа;
- «Последние закрытые сутки» – с начала и до конца последних истёкших суток;
- «Последние 7 дней» – с текущего момента последние 7 дней;
- «Последние 30 дней» – с текущего момента последние 30 дней;
- «Последний год» – все измерения, сделанные в текущем году;
- «Диапазон дат» – позволяет указать произвольный временной интервал.

Средние значения

Текущий час Текущие сутки Последний закрытый час Последние закрытые сутки Последние 7 дней

Последние 30 дней Последний год

от 18.10.2021 9:00:00 до 18.10.2021 9:02:46 Поток 1 Ввод

Экспорт Печать

Рисунок 33 – Средние значения. Фильтр

3.13 Отчёт

Для просмотра отчёта, выберите в главном меню программы [Измерения] → [Отчёт] и укажите период измерений и период, по которому провести группировку результатов анализа (34):

The screenshot shows the 'Отчет' (Report) page of a software application. The top navigation bar contains icons and labels for 'Измерения', 'Журналы', 'Градуировка', 'Датчики', 'Настройки', 'Пользователи', 'О программе', 'admin', and 'Выйти'. The left sidebar menu lists 'Измерения', 'Градуировки', 'Контроль градуировок', 'Средние значения', 'Отчет' (highlighted), 'Контрольные карты градуир. коэфф.', 'Тренды', and 'Тренды по параметрам'. The main content area is titled 'Отчет' and contains the following form fields:

- Дата от**: 10.06.2025 (with a calendar icon)
- Дата до**: 05.07.2025 (with a calendar icon)
- Поток**: 1 – Анализ (dropdown menu)
- Группировать по**: Без группировки (dropdown menu)
- Площадь пиков**: ☐
- Высота пиков**: ☐
- Время удержания**: ☐

A blue button labeled 'Ввод' is located at the bottom of the form.

Рисунок 34 – Отчёт

3.14 Контрольная карта градуировочных коэффициентов

Для просмотра карты Шухарта по градуировочным коэффициентам, выберите в главном меню программы [Измерения] → [Контрольная карта градуировочных коэффициентов] и укажите период измерений и компонент, по которому провести анализ (35):

The screenshot shows the 'Контрольная карта градуировочных коэффициентов' (Control Chart of Calibration Coefficients) interface. The top navigation bar includes links for 'Измерения', 'Журналы', 'Градуировка', 'Датчики', 'Настройки', 'Пользователи', 'О программе', 'admin', and 'Выйти'. The left sidebar menu lists: 'Измерения', 'Градуировки', 'Контроль градуировок', 'Средние значения', 'Отчет', 'Контрольные карты градуир. коэфф.' (highlighted), 'Тренды', and 'Тренды по параметрам'. The main content area has the title 'Контрольная карта градуировочных коэффициентов' and the following filters: 'от' (from) 09.07.2025, 'до' (to) 10.07.2025, 'Поток' (Flow) set to 'По всем' (All), and 'Наименование' (Name) set to 'пропан'. Below the filters are 'Ввод' (Input) and 'Экспорт' (Export) buttons. A 'Печать' (Print) button is located at the bottom right.

Рисунок 35 – Контрольная карта градуировочных коэффициентов

3.15 Тренды

Для просмотра тренда ко концентрации компонента, физико-химическому свойству, выберите в главном меню программы [Измерения] → [Тренды]. Для просмотра тренда по параметрам (время удержания, эффективность колонки) выберите в главном меню программы [Измерения] → [Тренды по параметрам] Укажите период измерений, период, по которому провести группировку и параметр по которому провести анализ(36, 37):

Измерения > Градуировки > Контроль градуировок > Средние значения > Отчет > Контрольные карты градуир. коэфф. > **Тренды** > Тренды по параметрам >

Тренд

Текущий час	Текущие сутки	Последний закрытый час	Последние закрытые сутки
Последние 7 дней	Последние 30 дней	Последний год	

от 09.07.2025 0:00:00

до 10.07.2025 8:37:05

Поток По всем

Группировать по Не группировать

Наименование пропан

Ввод Экспорт

Печать

Рисунок 36 – Тренды

Измерения > Градуировки > Контроль градуировок > Средние значения > Отчет > Контрольные карты градуир. коэфф. > Тренды > **Тренды по параметрам** >

Тренд по параметрам

Текущий час	Текущие сутки	Последний закрытый час	Последние закрытые сутки
Последние 7 дней	Последние 30 дней	Последний год	

от 09.07.2025 0:00:00

до 10.07.2025 8:37:45

Поток 1 – Анализ

Наименование компонента пропан

Наименование параметра Время удержания

Ввод Экспорт

Рисунок 37 – Тренды по параметрам

4 Настройки

Для изменения настроек основных модулей программы выберите [Настройки] в главном меню (38).

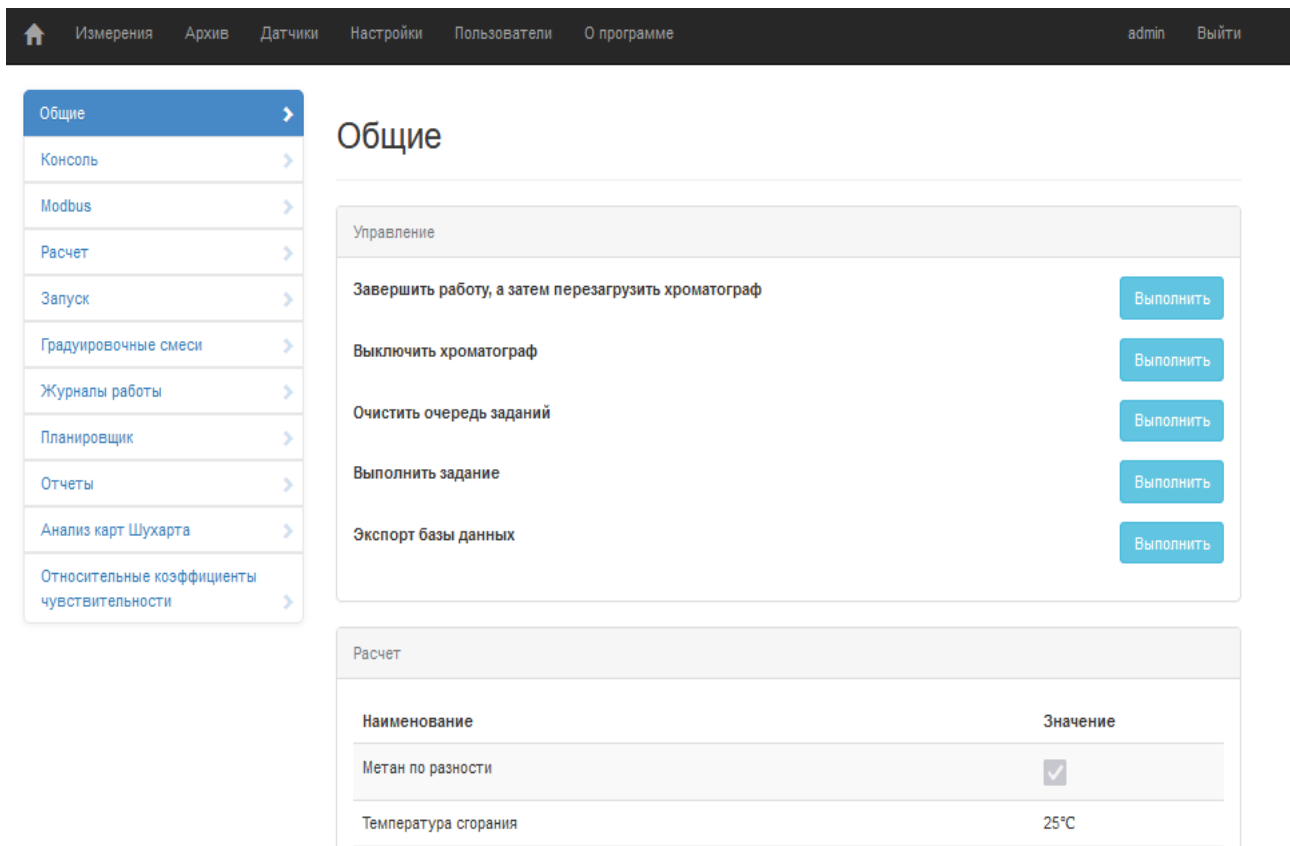


Рисунок 38 – Настройки

Управление

- «Завершить работу, а затем перезагрузить хроматограф» – при выборе этого действия происходит перезапуск всего программного обеспечения не дожидаясь завершения заданий;
- «Выключить хроматограф» – при выборе этого действия автоматизация ожидает завершения текущего задания, переходит в режим охлаждения и выключает систему;
- «Очистить очередь заданий» – убрать все задания из очереди (текущее задание продолжит выполнение);
- «Выполнить задание» – вручную добавляет задание в очередь;
- «Экспорт базы данных» – запускает процесс экспорта базы данных.

4.1 Консоль

Для смены языка интерфейса программы выберите [Настройки] → [Консоль] и в выпадающем списке укажите один из поддерживаемых языков, после чего нажмите сохранить (39).

Исмерения

Журналы

Градуировка

Датчики

Настройки

Пользователи

О программе

admin

Выйти

Общие

Консоль

Bot

Modbus

Расчет

Запуск

Смеси

Журналы работы

Планировщик

Отчеты

Анализ карт Шухарта

Относительные коэффициенты чувствительности

Плата управления клапанами

Группы компонентов

Пересчёты компонентов

Консоль

Сохранить

☐

Округление концентраций в соответствии с ГОСТ 31371.7-2020

☐

Округление ФХП в соответствии с ГОСТ 31369-2021

☒

Не показывать компоненты, включённые в группы

☒

Отображать исходные значения пересчитанных компонентов

Язык / Language

ru

Количество знаков после запятой

4

Период автообновления главной страницы (сек.)

3

Компоненты

Отметить имеющиеся в измерениях

Показывать

Наименование

☒

азот

☒

бутилмеркаптан☒☒

Рисунок 39 – Консоль

Физико-химические свойства

ГОСТ 31369-2008

ГОСТ 31369-2021

ГОСТ 34704-2020

ГОСТ 53367-2009

ГОСТ 34723-2021

Показывать	Наименование	
☒	Атмосферное давление	^ v
☒	Температура сгорания	^ v
☒	Плотность реального газа (кг/м3)	^ v
☒	Плотность идеального газа (кг/м3)	^ v
☒	Относительная плотность реального газа	^ v
☒	Относительная плотность идеального газа	^ v
☒	Высшая теплота сгорания массовая (МДж/кг)	^ v
☒	Высшая теплота сгорания массовая (ккал/кг)	^ v
☒	Низшая теплота сгорания массовая (МДж/кг)	^ v
☒	Низшая теплота сгорания массовая (ккал/кг)	^ v
☒	Высшая теплота сгорания молярная (кДж/моль)	^ v

Рисунок 40 – Консоль (продолжение)

Потоки

Показывать	Номер	Наименование
☒	1	Анализ
☒	2	Градуировка

Рисунок 41 – Консоль (продолжение)

Задания		
Показывать	Наименование	
☒	Градуировка	
☒	Градуировка ГОСТ 31371.7-2020 (Метод Б)	
☒	Градуировка ГОСТ 31371.7-2020 (Метод В2)	
☒	Измерение (ручная градуировка)	
☒	Измерение ГОСТ 31371.7-2008	
☒	Измерение ГОСТ 31371.7-2020 (Метод Б)	
☒	Измерение ГОСТ 31371.7-2020 (Метод В2)	
☒	Контроль градуировки ГОСТ 31371.7-2020 (Метод В2)	
☒	Сменить поток	
☐	Валидация	
☐	Градуировка ГОСТ 31371.7-2008	
☐	Градуировка ГОСТ 34723-2021 (нелинейная)	
☐	Градуировка ГОСТ 34723-2021 (линейная)	
☐	Градуировка ГОСТ 53367-2009 (нелинейная)	

Рисунок 42 – Консоль (продолжение)

Изменения отображение данных в приложении можно посредством опций:

- «Количество знаков после запятой» – устанавливает количество знаков после запятой;
- «Округление концентраций в соответствии с ГОСТ 31371.7-2020» – осуществлять округление концентраций в соответствии с ГОСТ 31371.7-2020;
- «Округление ФХП в соответствии с ГОСТ 31369-2021» – осуществлять округление ФХП в соответствии с ГОСТ 31369-2021;
- «Не показывать компоненты, включённые в группы» – скрывать индивидуальные компоненты, включённые в группы;
- «Отображать исходные значения пересчитанных компонентов» – отображать таблицу с концентрациями компонентов до пересчёта;
- «Период автообновления главной страницы (сек.)» – частота автообновления данных на главной странице;
- «Компоненты» – список компонентов, отображаемых в различных выпадающих списках. Нажатие на кнопку «Отметить имеющиеся в измерениях» автоматически активирует компоненты в измерениях, имеющихся в базе ПО.

Данная настройка не влияет на отображение компонентов в результатах измерений. В них всегда показывается полный компонентный состав, за исключением сгруппированных компонентов при активации настройки выше.

- «Физико-химические свойства» (40) – список свойств, отображаемых в результатах измерений и в различных выпадающих списках;
Для изменения порядка отображения свойств необходимо напротив свойства нажать на стрелку вверх или вниз.
- «Потоки» (41) – список потоков с наименованиями, отображаемых на главной странице и в выпадающих списках;
- «Задания» (42) – список заданий, отображаемых в различных выпадающих списках.

4.2 Modbus

Модуль Modbus может использоваться для передачи данных через последовательные линии связи RS-485 (поддерживается одновременно несколько интерфейсов Modbus RTU, по количеству COM-портов в системе), а также сети TCP/IP (Modbus TCP).

Рисунок 43 – Modbus

Для того чтобы изменить параметры запуска Modbus выберите [Настройки] → [Modbus]. Пользователю будет представлена следующая информация (43):

- «Независимые хранилища» – каждый интерфейс будет работать со своим независимым хранилищем регистров, запись в регистры одного интерфейса не повлияет на регистры другого. При отключении опции содержимое регистров синхронизировано по всем интерфейсам;
- «Modbus TCP» – запускать Modbus Slave TCP;
- «Modbus RTU» – запускать Modbus Slave RTU;
- «TCP порт» – номер TCP порта на котором запускать Modbus Slave TCP;
- «COM порт» – номер COM порта на котором запускать Modbus Slave RTU;
- «Скорость» – скорость передачи данных. Возможно указание следующих значения скоростной передачи: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;
- «Биты данных» – определяет число информационных бит в передаваемых и принимаемых байтах. Число информационных бит может быть в диапазоне от 4 до 8;
- «Чётность» – определяет выбор схемы контроля чётности. Данное поле должно содержать одно из следующих значений:
 - «None» – бит чётности отсутствует;
 - «Odd» – дополнение до нечётности;

- «Even» – дополнение до чётности;
 - «Mark» – бит чётности всегда 1;
 - «Space» – бит чётности всегда 0.
- «Стоповые биты» – задаёт количество стоповых бит;
- «Порядок байт» – задаёт порядок байт для интерфейса. Применяется если порядок байт не переопределён в файле modbus.xml (см. Раздел 6.4);
- «Добавить Modbus RTU» – добавляет интерфейс Modbus RTU при наличии незанятых СОМ-портов в системе;
- «Удалить Modbus RTU» – удаляет интерфейс Modbus RTU из конца списка. Самый первый интерфейс не удаляется.

4.3 Настройка автоматизации

Для изменения настроек системы автоматизации выберите [Настройки] → [Запуск] (44). Пользователю будет представлена следующая информация:

- «Запускаемые каналы» – количество каналов измерений;
- «Автоматизация» – указывает включать автоматизацию или нет;
- «Анализируемый поток» – номер анализируемого потока по умолчанию;
- «Градуировочный поток» – номер градуировочного потока по умолчанию;
- «Время продувки» – время выдержки после смены потока.
- «Время кондиционирования» – время кондиционирования колонки.

Настройка автоматизации

Рисунок 44 – Настройка автоматизации

4.4 Планировщик

Выбрав [Настройки] → [Планировщик] можно добавить или удалить задание в планировщик (45).

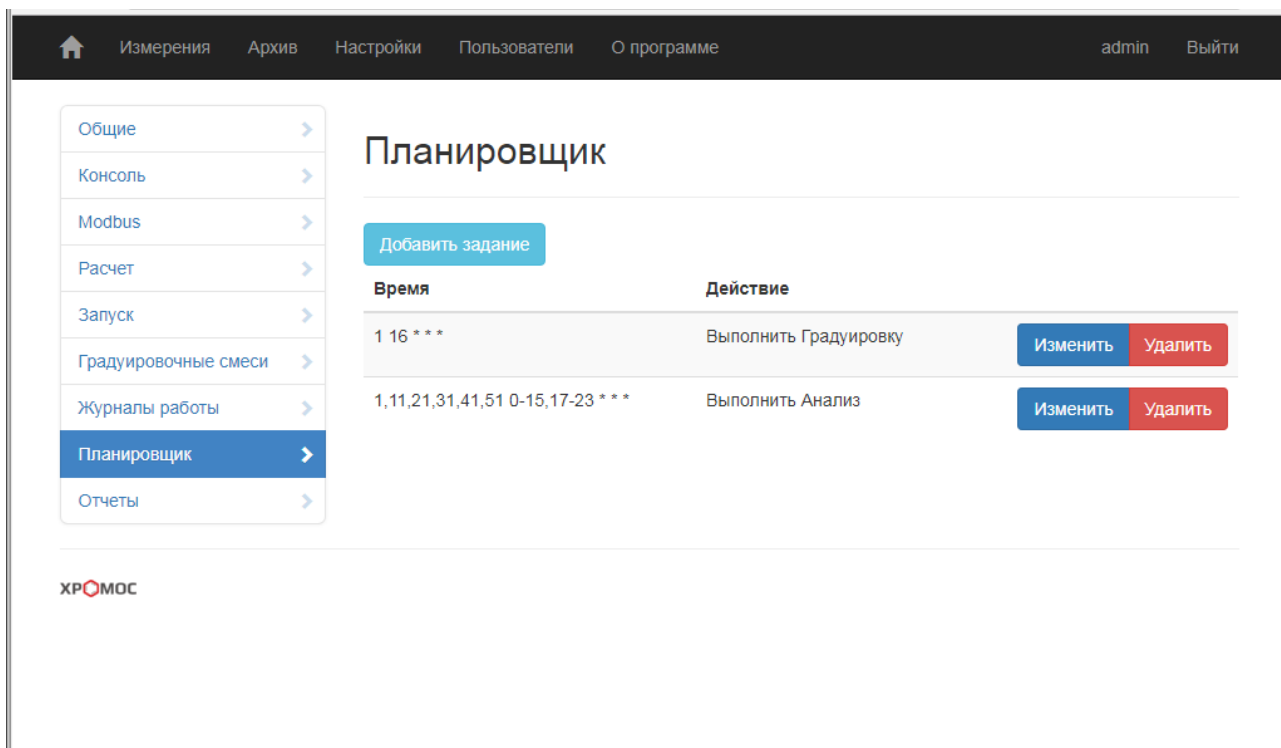


Рисунок 45 – Планировщик

Нажмите на кнопку [Добавить задание], чтобы создать новое задание (46).

Форма редактирования заданий содержит следующие поля:

- «Минута»;
- «Час»;
- «День»;
- «Месяц»;
- «День недели»;
- «Действие» – действие которой необходимо совершить по наступлению события:
 - «Выполнить Анализ»;
 - «Выполнить Градуировку».

Ввод можно осуществлять как через всплывающие диалоги так и вручную. Формат записи устанавливает что все значения вводятся через запятую, а символ '*' подразумевает любое значение.

Все условия (времени запуска) проверяются по «логическому И».

 Измерения

 Архив

 Настройки

 Пользователи

 О программе

admin

Выйти

Общие >

Консоль >

Modbus >

Расчет >

Запуск >

Градуировочные смеси >

Журналы работы >

Планировщик >

Отчеты >

Создать задание

Минута

*

Час

*

День

*

Месяц

*

День недели

*

Действие

Выполнить Анализ

Сохранить

[Назад к списку](#)

Рисунок 46 – Создать задание

4.5 Отчеты

Выбрав [Настройки] → [Отчеты] можно задать значения для дополнительных полей в отчётах (47).

- «Заголовок» – строка выводимая в начале отчёта;
- «Подпись» – строка выводимая в конце отчёта.

Общие >

Консоль >

Modbus >

Расчет >

Запуск >

Градуировочные смеси >

Журналы работы >

Планировщик >

Отчеты >

Отчеты

Заголовок природный газ от #d0# за период с #d1# по #d2#

Подпись оператор Иванов И.И.

Сохранить

XROMOS

Рисунок 47 – Отчеты

При вводе можно использовать подстановки:

- #d0# – текущее время;
- #d1# – время начала периода за который формируется отчёт;
- #d2# – время окончания периода за который формируется отчёт.

5 Идентификация программы

Для просмотра идентификационных данных ПО «Хромос Поток» (номер версии и контрольную сумму) выберите в главном меню [О программе] (48).

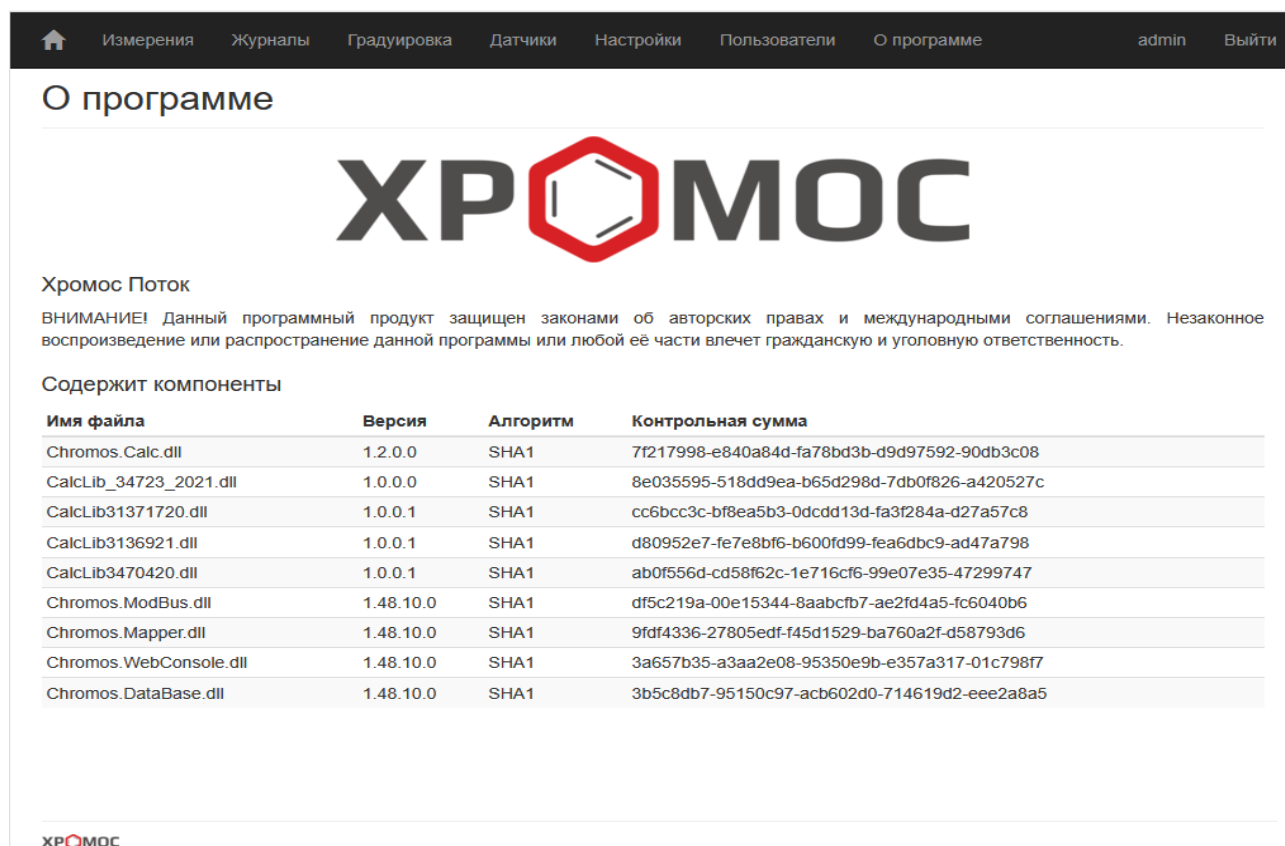


Рисунок 48 – О программе

В списке компонентов указывается:

- «Имя файла»;
- «Версия» – версия файла;
- «Алгоритм» – алгоритм по которому рассчитывалась контрольная сумма;
- «Контрольная сумма».

В целях защиты ПО от несанкционированного вмешательства реализована проверка контрольной суммы файла метрологически значимой части Chromos.Calc.dll, «Хромос: Природный газ» (модуль CalcLib31371720.dll), «Хромос: Природный газ» (модуль CalcLib3136921.dll), «Хромос: Серосодержащие в природном газе» (модуль CalcLib_34723_2021.dll), «Хромос: Природный газ» (модуль CalcLib3470420.dll)

В случае несоответствия контрольной суммы файла, измерения проводиться не будут.

6 Обмен данными

Основной коммуникационный порт для обмена данными это порт TCP/IP. Также доступен порт Modbus RTU. Порт TCP/IP (Gigabit Ethernet) необходим для подключения к консоли управления хроматографа по протоколу HTTP (для конфигурации, диагностики и создания отчётов), но может использоваться совместно с Modbus TCP/IP.

6.1 Протокол Modbus

В ПО «Хромос Поток» карта Modbus является настраиваемой, в ней можно изменять адреса регистров и способ кодирования.

Все передаваемые/устанавливаемые параметры типа Дата/время в формате UnixTime определены как количество секунд, прошедших с полуночи (00:00:00) 1 января 1970 года по местному времени.

6.2 Протокол Modbus. По умолчанию

В протоколе MODBUS число FLOAT представляется в виде двух регистров:

Регистр с адресом XXXX		Регистр с адресом XXXX+1	
Байт 3	Байт 4	Байт 1	Байт 2

	Код функции:		4 READ IR
Адрес	Наименование	Компонент	Тип данных
Данные о приборе			
0	Резерв		UINT (16-bit)
	Значения:		
	Текущая версия протокола 1		
1	Код ошибки прибора (Error.Chromos)		UINT (16-bit)
2	Код ошибки автоматизации (Error.Bot)		UINT (16-bit)
3	Код ошибки автоматизации (Signal.Alarm)		UINT (16-bit)
4	Код режима прибора (Device.Mode)		UINT (16-bit)
5	Резерв		UINT (16-bit)
6	Резерв		UINT (16-bit)
7	Резерв		UINT (16-bit)
8	Резерв		UINT (16-bit)
9	Резерв		UINT (16-bit)
Последний анализ			
Дата проведения анализа			
10	Year (Дата проведения анализа)		UINT (16-bit)
11	Month		UINT (16-bit)

12	Day		UINT (16-bit)
13	Hour		UINT (16-bit)
14	Minute		UINT (16-bit)
15	Second		UINT (16-bit)
16	Type (Статус анализа)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – Успешно		
	1 – Градуировка		
	2 – Ручной режим		
	3 – Градуировочная смесь не соответствует анализируемому газу		
	4 – Контрольное измерение		
Физико-химические свойства			
17	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
19	M (Молярная масса)		FLOAT
21	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
23	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
25	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
27	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
29	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
31	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
33	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
35	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
37	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
39	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
41	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
43	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
45	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT
47	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
49	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
51	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
53	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)

54	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
55	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
56	ButylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, бутилмеркаптан)		FLOAT
58	CarbonylSulfideSulphur (Массовая концентрация серы, карбонилсульфид)		FLOAT
60	EthylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, этилмеркаптан)		FLOAT
62	HydrogenSulphideSulphur (Массовая концентрация серы, сероводород)		FLOAT
64	IsobutylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, изобутилмеркаптан)		FLOAT
66	IsopropylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, изопропилмеркаптан)		FLOAT
68	MethylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, метилмеркаптан)		FLOAT
70	PropylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, пропилмеркаптан)		FLOAT
72	SecButylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, втор-бутилмеркаптан)		FLOAT
74	TertButylMercaptanSulphur (Массовая концентрация меркаптановой серы, трет-бутилмеркаптан)		FLOAT
76	TotalMercaptanSulphur (Суммарная массовая концентрация меркаптановой серы)		FLOAT
78	GenericSulphur (Массовая концентрация общей серы)		FLOAT

Компоненты			
100	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - Σ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
102	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
104	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
106	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
108	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
110	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
112	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
114	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
116	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
118	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
120	11 Молярная доля, %	2-метилпентан	FLOAT
122	12 Молярная доля, %	3-метилпентан	FLOAT
124	13 Молярная доля, %	2.2-диметилбутан	FLOAT
126	14 Молярная доля, %	2.3-диметилбутан	FLOAT
128	15 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
130	16 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
132	17 Молярная доля, %	н-нонан	FLOAT
134	18 Молярная доля, %	н-декан	FLOAT
136	19 Молярная доля, %	этилен	FLOAT
138	20 Молярная доля, %	пропилен	FLOAT
140	21 Молярная доля, %	1-бутен	FLOAT
142	22 Молярная доля, %	цис-2-бутен	FLOAT
144	23 Молярная доля, %	транс-2-бутен	FLOAT
146	24 Молярная доля, %	2-метилпропен	FLOAT
148	25 Молярная доля, %	1-пентен	FLOAT
150	26 Молярная доля, %	пропадиен	FLOAT
152	27 Молярная доля, %	1.2-бутадиен	FLOAT
154	28 Молярная доля, %	1.3-бутадиен	FLOAT
156	29 Молярная доля, %	ацетилен	FLOAT
158	30 Молярная доля, %	циклопентан	FLOAT
160	31 Молярная доля, %	метилциклопентан	FLOAT
162	32 Молярная доля, %	этилциклопентан	FLOAT
164	33 Молярная доля, %	циклогексан	FLOAT
166	34 Молярная доля, %	метилциклогексан	FLOAT
168	35 Молярная доля, %	этилциклогексан	FLOAT
170	36 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
172	37 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
174	38 Молярная доля, %	этилбензол	FLOAT
176	39 Молярная доля, %	о-ксилол	FLOAT

178	40 Молярная доля, %	метанол	FLOAT
180	41 Молярная доля, %	метантиол	FLOAT
182	42 Молярная доля, %	водород	FLOAT
184	43 Молярная доля, %	вода	FLOAT
186	44 Молярная доля, %	сероводород	FLOAT
188	45 Молярная доля, %	аммиак	FLOAT
190	46 Молярная доля, %	цианид водорода	FLOAT
192	47 Молярная доля, %	монооксид углерода	FLOAT
194	48 Молярная доля, %	карбонилсульфид	FLOAT
196	49 Молярная доля, %	сероуглерод	FLOAT
198	50 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
200	51 Молярная доля, %	неон	FLOAT
202	52 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
204	53 Молярная доля, %	азот	FLOAT
206	54 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
208	55 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
210	56 Молярная доля, %	диоксид серы	FLOAT
212	57 Молярная доля, %	воздух	FLOAT
214	58 Молярная доля, %	изобутилен	FLOAT
216	59 Молярная доля, %	акролеин	FLOAT
218	60 Молярная доля, %	C5+	FLOAT
220	61 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
222	62 Молярная доля, %	изопропанол	FLOAT
224	63 Молярная доля, %	тетрагидрофуран	FLOAT
226	64 Молярная доля, %	метилацетилен	FLOAT
228	65 Молярная доля, %	винилциклогексен	FLOAT
230	66 Молярная доля, %	ацетонитрил	FLOAT
232	67 Молярная доля, %	нак	FLOAT
234	68 Молярная доля, %	метилмеркаптан	FLOAT
236	69 Молярная доля, %	этилмеркаптан	FLOAT
238	70 Молярная доля, %	пропилмеркаптан	FLOAT
240	71 Молярная доля, %	изопропилмеркаптан	FLOAT
242	72 Молярная доля, %	втор-бутилмеркаптан	FLOAT
244	73 Молярная доля, %	трет-бутилмеркаптан	FLOAT
246	74 Молярная доля, %	изобутилмеркаптан	FLOAT
248	75 Молярная доля, %	бутилмеркаптан	FLOAT

Входящие команды

	Код функции:	1, 5	Read Coils, Write Single Coil
Адрес	Наименование	Описание	
0	InCommand.PreparationComplete	Успешная	

		пробоподготовка	
1	InCommand.PreparationError	Ошибка пробоподготовки	
2	InCommand.StartAnalysis	Запуск анализа	
3	InCommand.StartCalibration	Запуск градуировки	
Исходящие команды			
	Код функции:	2	Read Discrete Inputs
Адрес	Наименование	Описание	
0	OutCommand.StartPreparation	Начать пробоподготовку	
1	OutCommand.AnalysisEnded	Анализ завершён	
Параметры, доступные для чтения и записи			
	Код функции:	3, 16	Read Holding Registers, Write Holding Registers
Адрес	Наименование	Описание	Тип данных
0	SystemDate.UnixTime	Чтение/задание системного времени	UINT (32-bit)
2	IsArchiveMode	Переключение текущего/архивного режимов	UINT (32-bit)
4	AvgFromDate.UnixTime, оператор avg_hour_closed	Дата/время начала усреднения часовых параметров	UINT (32-bit)
6	AvgFromDate.UnixTime, оператор avg_day_closed	Дата/время начала усреднения суточных параметров	UINT (32-bit)

6.3 Протокол Modbus по требованиям СТО Газпром 5.37-2011, СТО Газпром 5.37-2020

В протоколе MODBUS число FLOAT представляется в виде двух регистров:

Регистр с адресом XXXX		Регистр с адресом XXXX+1	
Байт 3	Байт 4	Байт 1	Байт 2
	Код функции:	4	Read Input Registers
Адрес	Наименование	Компонент	Тип данных
Данные о приборе			
0	Резерв		UINT (16-bit)

	Значения:		
	Текущая версия протокола 1		
1	Код ошибки прибора (Error.Chromos)		UINT (16-bit)
2	Код ошибки автоматизации (Error.Bot)		UINT (16-bit)
3	Код ошибки автоматизации (Signal.Alarm)		UINT (16-bit)
4	Код режима прибора (Device.Mode)		UINT (16-bit)
5	Резерв		UINT (16-bit)
6	Резерв		UINT (16-bit)
7	Резерв		UINT (16-bit)
Последний анализ			
Дата проведения анализа			
8	UnixTime		UINT (32-bit)
10	Year (Дата проведения анализа)		UINT (16-bit)
11	Month		UINT (16-bit)
12	Day		UINT (16-bit)
13	Hour		UINT (16-bit)
14	Minute		UINT (16-bit)
15	Second		UINT (16-bit)
16	Type (Статус анализа)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – Успешно		
	1 – Градуировка		
	2 – Ручной режим		
	3 – Градуировочная смесь не соответствует анализируемому газу		
	4 – Контрольное измерение		
Физико-химические свойства			
17	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
19	M (Молярная масса)		FLOAT
21	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
23	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
25	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
27	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
29	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
31	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT

33	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
35	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
37	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
39	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
41	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
43	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
45	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT
47	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
49	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
51	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
53	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)
54	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
55	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
Компоненты			
60	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - $\sum$ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
62	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
64	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
66	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
68	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
70	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
72	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
74	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
76	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
78	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
80	11 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
82	12 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
84	13 Молярная доля, %	бензол	FLOAT

86	14 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
88	15 Молярная доля, %	водород	FLOAT
90	16 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
92	17 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
94	18 Молярная доля, %	азот	FLOAT
96	19 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
98	20 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
100	21 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
Среднечасовые значения (последний закрытый час)			
Дата и время начала усреднения			
108	UnixTime		UINT (32-bit)
110	Year		UINT (16-bit)
111	Month		UINT (16-bit)
112	Day		UINT (16-bit)
113	Hour		UINT (16-bit)
114	Minute		UINT (16-bit)
115	Second		UINT (16-bit)
Физико-химические свойства			
117	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
119	M (Молярная масса)		FLOAT
121	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
123	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
125	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
127	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
129	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
131	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
133	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
135	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
137	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
139	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
141	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
143	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
145	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT

147	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
149	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
151	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
153	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)
154	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
155	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
Компоненты			
160	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - Σ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
162	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
164	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
166	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
168	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
170	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
172	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
174	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
176	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
178	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
180	11 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
182	12 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
184	13 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
186	14 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
188	15 Молярная доля, %	водород	FLOAT
190	16 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
192	17 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
194	18 Молярная доля, %	азот	FLOAT
196	19 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
198	20 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
200	21 Молярная доля, %	C6+	FLOAT

Среднесуточные значения (последние закрытые сутки)			
Дата и время начала усреднения			
208	UnixTime		UINT (32-bit)
210	Year		UINT (16-bit)
211	Month		UINT (16-bit)
212	Day		UINT (16-bit)
213	Hour		UINT (16-bit)
214	Minute		UINT (16-bit)
215	Second		UINT (16-bit)
Физико-химические свойства			
217	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
219	M (Молярная масса)		FLOAT
221	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
223	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
225	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
227	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
229	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
231	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
233	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
235	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
237	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
239	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
241	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
243	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
245	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT
247	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
249	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
251	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
253	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)
254	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		

	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
255	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
Компоненты			
260	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - Σ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
262	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
264	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
266	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
268	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
270	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
272	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
274	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
276	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
278	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
280	11 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
282	12 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
284	13 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
286	14 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
288	15 Молярная доля, %	водород	FLOAT
290	16 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
292	17 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
294	18 Молярная доля, %	азот	FLOAT
296	19 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
298	20 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
300	21 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
Среднечасовые значения (с начала текущего часа)			
Дата и время начала усреднения			
308	UnixTime		UINT (32-bit)
310	Year		UINT (16-bit)
311	Month		UINT (16-bit)
312	Day		UINT (16-bit)
313	Hour		UINT (16-bit)
314	Minute		UINT (16-bit)
315	Second		UINT (16-bit)

Физико-химические свойства			
317	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
319	M (Молярная масса)		FLOAT
321	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
323	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
325	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
327	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
329	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
331	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
333	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
335	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
337	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
339	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
341	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
343	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
345	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT
347	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
349	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
351	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
353	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)
354	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
355	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
Компоненты			

360	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - Σ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
362	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
364	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
366	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
368	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
370	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
372	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
374	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
376	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
378	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
380	11 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
382	12 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
384	13 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
386	14 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
388	15 Молярная доля, %	водород	FLOAT
390	16 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
392	17 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
394	18 Молярная доля, %	азот	FLOAT
396	19 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
398	20 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
400	21 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
Среднесуточные значения (с начала текущих суток)			
Дата и время начала усреднения			
408	UnixTime		UINT (32-bit)
410	Year		UINT (16-bit)
411	Month		UINT (16-bit)
412	Day		UINT (16-bit)
413	Hour		UINT (16-bit)
414	Minute		UINT (16-bit)
415	Second		UINT (16-bit)
Физико-химические свойства			
417	Zmix (Коэффициент сжимаемости)		FLOAT
419	M (Молярная масса)		FLOAT
421	HmolV (Высшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
423	HmolN (Низшая теплота сгорания молярная (и реального, и идеального газа))		FLOAT
425	HmassV (Высшая теплота сгорания массовая (и		FLOAT

	реального, и идеального газа))		
427	HmassN (Низшая теплота сгорания массовая (и реального, и идеального газа))		FLOAT
429	HvolV0 (Высшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
431	HvolN0 (Низшая теплота сгорания объёмная (идеального газа))		FLOAT
433	HvolV (Высшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
435	HvolN (Низшая теплота сгорания объёмная (реального газа))		FLOAT
437	Ro0 (Плотность идеального газа)		FLOAT
439	Ro (Плотность реального газа)		FLOAT
441	D0 (Относительная плотность идеального газа)		FLOAT
443	D (Относительная плотность реального газа)		FLOAT
445	WobbeV0 (Число Воббе высшее идеального газа)		FLOAT
447	WobbeN0 (Число Воббе низшее идеального газа)		FLOAT
449	WobbeV (Число Воббе высшее реального газа)		FLOAT
451	WobbeN (Число Воббе низшее реального газа)		FLOAT
453	IsMethaneByDifference (Метан по разности)		UINT (16-bit)
454	BurnoutTemperature (Температура сгорания)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
	3 – 25 градусов по Цельсию		
455	MeasureTemperature (Температура измерения)		UINT (16-bit)
	Значения:		
	0 – 0 градусов по Цельсию		
	1 – 15 градусов по Цельсию		
	2 – 20 градусов по Цельсию		
Компоненты			
460	1 Молярная доля, %	вывод разницы (100 - Σ концентраций всех компонентов хроматограммы)	FLOAT
462	2 Молярная доля, %	метан	FLOAT
464	3 Молярная доля, %	этан	FLOAT
466	4 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
468	5 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
470	6 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT

472	7 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
474	8 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
476	9 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
478	10 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
480	11 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
482	12 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
484	13 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
486	14 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
488	15 Молярная доля, %	водород	FLOAT
490	16 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
492	17 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
494	18 Молярная доля, %	азот	FLOAT
496	19 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
498	20 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
500	21 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
Состав градуировочного газа			
502	Mixture.1.Ro (абсолютная плотность градуировочной смеси)		FLOAT
504	Mixture.1.HmolN (низшая теплота сгорания градуировочной смеси)		FLOAT
506	1 Молярная доля, %	метан	FLOAT
508	2 Молярная доля, %	этан	FLOAT
510	3 Молярная доля, %	пропан	FLOAT
512	4 Молярная доля, %	н-бутан	FLOAT
514	5 Молярная доля, %	и-бутан	FLOAT
516	6 Молярная доля, %	н-пентан	FLOAT
518	7 Молярная доля, %	и-пентан	FLOAT
520	8 Молярная доля, %	нео-пентан	FLOAT
522	9 Молярная доля, %	н-гексан	FLOAT
524	10 Молярная доля, %	н-гептан	FLOAT
526	11 Молярная доля, %	н-октан	FLOAT
528	12 Молярная доля, %	бензол	FLOAT
530	13 Молярная доля, %	толуол	FLOAT
532	14 Молярная доля, %	водород	FLOAT
534	15 Молярная доля, %	гелий	FLOAT
538	16 Молярная доля, %	аргон	FLOAT
540	17 Молярная доля, %	азот	FLOAT
542	18 Молярная доля, %	кислород	FLOAT
544	19 Молярная доля, %	диоксид углерода	FLOAT
546	20 Молярная доля, %	C6+	FLOAT
Журнал вмешательств			

Адрес	Наименование параметра	Описание	Тип данных
600	Intervention.TotalRows	Общее количество найденных записей в журнале (от заданного времени)	UINT (32-bit)
602	Intervention.UnixTime	Дата/время выбранного вмешательства в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
604	Intervention.Code	Код вмешательства	UINT (32-bit)
606	Intervention.OldValue	Старое значение параметра	UINT (32-bit) / FLOAT
608	Intervention.NewValue	Новое значение параметра	UINT (32-bit) / FLOAT
Журнал нештатных ситуаций			
700	ErrorMessage.TotalRows	Общее количество найденных записей в журнале (от заданного времени)	UINT (32-bit)
702	ErrorMessage.UnixTime	Дата/время выбранной ошибки в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
704	ErrorMessage.Type	Тип ошибки	UINT (32-bit)
	Значения:		
	1 – ошибка прибора (коды ошибок соответствуют параметру Error.Chromos)		
	2 – ошибка автоматизации (коды ошибок соответствуют параметру Error.Bot)		
706	ErrorMessage.Code	Код ошибки	UINT (32-bit)
Входящие команды			
	Код функции:		Read Coils, 1, 5 Write Single Coil
Адрес	Наименование	Описание	
0	InCommand.PreparationComplete	Успешная пробоподготовка	
1	InCommand.PreparationError	Ошибка пробоподготовки	
2	InCommand.StartAnalysis	Запуск анализа	
3	InCommand.StartCalibration	Запуск градуировки	
Исходящие команды			

	Код функции:	2	Read Discrete Inputs
Адрес	Наименование	Описание	
0	OutCommand.StartPreparation	Начать пробоподготовку	
1	OutCommand.AnalysisEnded	Анализ завершён	
Параметры, доступные для чтения и записи			
	Код функции:	3, 16	Read Holding Registers, Write Holding Registers
Адрес	Наименование	Описание	Тип данных
0	SystemDate.UnixTime	Чтение/задание системной даты и времени в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
2	IsArchiveMode	Переключение текущего/архивного режимов (см. описание в п. 6.4)	UINT (32-bit)
4	AvgFromDate.UnixTime, оператор avg_hour_closed	Дата/время начала усреднения часовых параметров в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
6	AvgFromDate.UnixTime, оператор avg_day_closed	Дата/время начала усреднения суточных параметров в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
8	Intervention.StartDate	Дата/время начала выборки записей журнала вмешательств в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
10	Intervention.CurrentRow	Номер отображаемой записи в регистрах 602-608.	UINT (32-bit)
12	ErrorMessage.StartDate	Дата/время начала выборки записей журнала нештатных ситуаций в формате unix time 32 бита	UINT (32-bit)
14	ErrorMessage.CurrentRow	Номер отображаемой записи в регистрах 702-706.	UINT (32-bit)
16	ContractHour	Чтение/задание контрактного	UINT (32-bit)

		(расчётного) часа, 0-23	
--	--	-------------------------	--

6.4 Настройка карты Modbus

Настройка карты Modbus осуществляется посредством редактирования файла «modbus.xml». Редактировать файл можно вручную, изменяя XML-код посредством любого текстового редактора.

Корневым элементом «modbus.xml» является <modbus>. Помимо данного элемента обязательными элементами являются теги <group> и <param>. Порядок расположения элементов, находящихся на одном уровне, произвольный. Все значения устанавливаются через атрибуты элементов.

<modbus> – элемент является корневым элементом. По умолчанию элемент содержит два атрибута:

```
<modbus xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://office.has.ru/files/modbus.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
```

- xmlns:xsi – определяет пространство имён. Оно всегда одно и то же;
- xsi:noNamespaceSchemaLocation – ссылка на схему XSD в документа. Оно всегда одно и то же.

<group> – элемент задаёт группу параметров или команд для потока:

```
<group flow="0">
```

- flow – номер потока, нумерация от 0

<command> – элемент задаёт команду

```
<command addr="0" data_type="Coil" name="InCommand.StartAnalysis"/>
```

Атрибуты:

- **addr** – адрес команды
- **data_type** – тип регистра:
 - Coil – однобитовый тип, доступен для чтения и записи – для команд устройству (InCommand)
 - Input – однобитовый тип, доступен только для чтения – для команд от устройства (OutCommand), например для внешней системы пробоподготовки
- **name** – наименование команды:
 - InCommand.StartAnalysis – запуск измерения
 - InCommand.StartCalibration – запуск градуировки
 - Дополнительные команды при работе с комплексной внешней пробоподготовкой (например на базе ПЛК):
 - OutCommand.StartPreparation – сигнал внешней пробоподготовке о необходимости начала подготовки пробы
 - OutCommand.AnalysisEnded – сигнал внешней пробоподготовке об окончании измерения
 - InCommand.PreparationComplete – сигнал от внешней пробоподготовки об

- успешной подготовке пробы (можно начинать измерение)
- InCommand.PreparationError – сигнал от внешней пробоподготовки об ошибке при подготовке пробы (измерение провести нельзя)

<param> – элемент определяет тип и расположение элемента в карте Modbus.

```
<param addr="19" data_type="InputRegister" reverse_bytes="false" reverse_words="true"
operator="avg_hour" type="float" name="Property.Gost313692008M" />
```

Атрибуты:

- **addr** – адрес первого регистра параметра в десятичном виде;
- **data_type** – тип регистра:
 - HoldingRegister
 - InputRegister
 - Coil
 - Input
- **reverse_bytes** – если "true", меняет порядок байт в каждом регистре на "старший байт первым". Этот параметр может быть указан также у элементов «**modbus**», «**group**» для задания порядка нижестоящим группам элементов. При его использовании игнорируются настройки порядка байт, заданные в интерфейсе;
- **reverse_words** – если "true", меняет порядок регистров на "старший регистр первым". Этот параметр может быть указан также у элементов «**modbus**», «**group**» для задания порядка нижестоящим группам элементов. При его использовании игнорируются настройки порядка байт, заданные в интерфейсе;
- **operator** – определяет усреднение данных; если отсутствует – выдаются текущие значения. Усреднение поддерживает компоненты Component.* и расчётные параметры Property.*, а также дату и время начала и конца усреднения (см. ниже)
 - avg_hour_closed – усреднение за последний закрытый час
 - avg_day_closed – усреднение за последние закрытые сутки
 - avg_hour_current – усреднение с начала текущего часа
 - avg_day_current – усреднение с начала текущих суток
- **type** – значение какого типа потребуется записать в блок данных:
 - i16 – знаковое целое 16 бит;
 - ui16 – беззнаковое целое 16 бит;
 - i32 – знаковое целое 32 бита;
 - ui32 – беззнаковое целое 32 бита;
 - float – число с плавающей запятой 32 бита;
 - double – число с плавающей запятой 64 бита;
- **name** – наименование параметра:
 - Error.Chromos – код ошибки прибора:
 - 1 – перегрев;
 - 2 – перегрев колонок;
 - 3 – перегрев испарителя;
 - 4 – перегрев испарителя 1;
 - 5 – перегрев испарителя 2;
 - 6 – перегрев детектора;
 - 7 – перегрев детектора 1;
 - 8 – перегрев детектора 2;
 - 9 – обрыв тсп;
 - 10 – обрыв тсп колонок;
 - 11 – обрыв тсп испарителя;

- 12 – обрыв тсп испарителя 1;
- 13 – обрыв тсп испарителя 2;
- 14 – обрыв тсп детектора;
- 15 – обрыв тсп детектора 1;
- 16 – обрыв тсп детектора 2;
- 17 – короткое замыкание тсп;
- 18 – короткое замыкание тсп колонок;
- 19 – короткое замыкание тсп испарителя;
- 20 – короткое замыкание тсп испарителя 1;
- 21 – короткое замыкание тсп испарителя 2;
- 22 – короткое замыкание тсп детектора;
- 23 – короткое замыкание тсп детектора 1;
- 24 – короткое замыкание тсп детектора 2;
- 25 – невозможно подать газ 1;
- 26 – невозможно подать газ 2;
- 27 – невозможно подать газ 3;
- 28 – невозможно подать газ 4;
- 29 – невозможно подать газ 5;
- 30 – невозможно подать газ 6;
- 31 – невозможно подать газ 7;
- 32 – невозможно подать газ 8;
- 33 – невозможно подать водород;
- 34 – невозможно подать воздух;
- 35 – невозможно подать водород2;
- 36 – невозможно подать воздух2;
- 37 – сработала защита спирали дтп;
- 38 – невозможно идентифицировать термостатируемый объект с ошибкой;
- 39 – ошибка кранов – невозможно переключиться;
- 40 – ошибка кранов – долгое переключение;
- 41 – ошибка кранов – кран заклинило;
- 42 – ошибка кранов – непонятный тип крана;
- 43 – внутренняя ошибка прибора – сбой ацп температур;
- 44 – пропало пламя;
- 45 – ошибка даж;
- 46 – конфигурация температурных зон прибора не верна;
- 47 – невозможно загрузить из прибора названия всех температурных зон;
- 48 – перегрев зоны 0;
- 49 – перегрев зоны 1;
- 50 – перегрев зоны 2;
- 51 – перегрев зоны 3;
- 52 – перегрев зоны 4;
- 53 – перегрев зоны 5;
- 54 – перегрев зоны 6;
- 55 – перегрев зоны 7;
- 56 – обрыв тсп зоны 0;
- 57 – обрыв тсп зоны 1;
- 58 – обрыв тсп зоны 2;
- 59 – обрыв тсп зоны 3;
- 60 – обрыв тсп зоны 4;
- 61 – обрыв тсп зоны 5;
- 62 – обрыв тсп зоны 6;

- 63 – обрыв тсп зоны 7;
- 64 – короткое замыкание тсп зоны 0;
- 65 – короткое замыкание тсп зоны 1;
- 66 – короткое замыкание тсп зоны 2;
- 67 – короткое замыкание тсп зоны 3;
- 68 – короткое замыкание тсп зоны 4;
- 69 – короткое замыкание тсп зоны 5;
- 70 – короткое замыкание тсп зоны 6;
- 71 – короткое замыкание тсп зоны 7;
- 72 – перегрев дополнительной зоны 0;
- 73 – перегрев дополнительной зоны 1;
- 74 – перегрев дополнительной зоны 2;
- 75 – перегрев дополнительной зоны 3;
- 76 – перегрев дополнительной зоны 4;
- 77 – обрыв тсп дополнительной зоны 0;
- 78 – обрыв тсп дополнительной зоны 1;
- 79 – обрыв тсп дополнительной зоны 2;
- 80 – обрыв тсп дополнительной зоны 3;
- 81 – обрыв тсп дополнительной зоны 4;
- 82 – короткое замыкание тсп дополнительной зоны 0;
- 83 – короткое замыкание тсп дополнительной зоны 1;
- 84 – короткое замыкание тсп дополнительной зоны 2;
- 85 – короткое замыкание тсп дополнительной зоны 3;
- 86 – короткое замыкание тсп дополнительной зоны 4;
- 87 – превышено максимальное давление газа;
- 88 – ошибка в приборе;
- 89 – плохая сеть 220в;
- 90 – невозможно поджечь пламя;
- 91 – msg—;
- 92 – ошибка связи;
- 93 – ошибка связи – данные не поступают;
- 94 – ошибка связи – ошибка crc;
- 95 – поиск синхробайт;
- 96 – ошибка связи – параметр не записан;
- 97 – проверка целостности ПО Хромос не пройдена
- 100 – ожидание подачи газа;
- Error.Bot – код ошибки автоматизации:
 - 2 – проверка целостности метрологически значимой части ПО Хромос Поток не пройдена;
 - 3 – аварийное завершение работы;
 - 4 – неисправен индикатор водорода;
 - 5 – превышение концентрации водорода;
 - 6 – неисправен индикатор температуры пробы;
 - 7 – температура пробы ниже заданной;
 - 8 – неисправен индикатор расхода;
 - 9 – пониженный уровень расхода пробы;
 - 10 – ошибка Анализатора FAS–W;
 - 11 – выход из диапазона измерения Анализатора FAS–W;
 - 12 – ошибка Преобразователя КОНГ–Прима–2М;
 - 13 – выход из диапазона измерения Преобразователя КОНГ–Прима–2М;
 - 14 – градуировка неудачна;

- 15 – ошибка датчика давления МИДА–15;
- 16 – выход из диапазона измерения датчика давления МИДА–15;
- 17 – ошибка датчика давления КОРУНД–Дх–001MRS;
- 18 – выход из диапазона измерения датчика давления КОРУНД–Дх–001MRS;
- 19 – ошибка датчика;
- 20 – выход из диапазона измерения датчика;
- 21 – проверка целостности неизменной части ПО не пройдена
- 100 – Некорректное измерение;
- 101 – Ошибка пробоподготовки при выполнении задания;
- 102 – Ошибка запроса внешних параметров при выполнении задания;
- 103 – Полученное при выполнении задания количество файлов хроматограмм меньше числа каналов;
- 104 – Отсутствуют привязанные к потоку методы и каналы;
- 105 – Отсутствует активная градуировка для данного потока и вида зависимости;
- 106 – Ошибка подключения к прибору;
- 107 – Ошибка при переключении потока при выполнении задания;
- 108 – Тайм-аут выполнения задания;
- 200 – Аварийное выключение из-за достижения установленного % от НКПР водорода;
- 400 – Валидация неудачна;
- Device.Mode – код режима прибора:
 - 0 – прибор остановлен;
 - 1 – подготовка к анализу;
 - 2 – подготовка к поджигу;
 - 3 – осуществляется поджиг;
 - 4 – установка заданных температур и газов;
 - 5 – прибор готов к записи;
 - 6 – анализ (T1);
 - 7 – анализ (V12);
 - 8 – анализ (T2);
 - 9 – анализ (V23);
 - 10 – анализ (T3);
 - 11 – анализ (V34);
 - 12 – анализ (T4);
 - 13 – анализ (V45);
 - 14 – анализ (T5);
 - 15 – остановка анализа;
 - 16 – продувка;
 - 17 – охлаждение прибора;
 - 18 – резерв (устар.);
 - 19 – ошибка в приборе;
 - 20 – ожидание ввода дозатором;
 - 21 – ожидание подачи газа;
- Signal.Alarm- код ошибки автоматизации:
 - 0 – анализ на канале завершён успешно;
 - 1 – анализ на канале не был завершён за отведённое время;
- AssayDate.Year – время измерения, год;
- AssayDate.Month – время измерения, месяц;
- AssayDate.Day – время измерения, день;
- AssayDate.Hour – время измерения, час;

- AssayDate.Minute – время измерения, минута;
- AssayDate.Second – время измерения, секунда;
- AssayDate.UnixTime – время измерения, в формате unix time 32 бита
- **Компоненты:**
- Component.methane – компонент «метан»;
- Component.ethane – компонент «этан»;
- Component.propane – компонент «пропан»;
- Component.n_butane – компонент «н-бутан»;
- Component.iso_butane – компонент «и-бутан»;
- Component.n_pentane – компонент «н-пентан»;
- Component.isopentane – компонент «и-пентан»;
- Component.neopentane – компонент «нео-пентан»;
- Component.n_hexane – компонент «н-гексан»;
- Component.2_methylpentane – компонент «2-метилпентан»;
- Component.3_methylpentane – компонент «3-метилпентан»;
- Component.2_2_dimethylbutane – компонент «2.2-диметилбутан»;
- Component.2_3_dimethylbutane – компонент «2.3-диметилбутан»;
- Component.n_heptane – компонент «н-гептан»;
- Component.n_octane – компонент «н-октан»;
- Component.nonane – компонент «н-нонан»;
- Component.n_decane – компонент «н-декан»;
- Component.ethylene – компонент «этилен»;
- Component.propylene – компонент «пропилен»;
- Component.1_butene – компонент «1-бутен»;
- Component.cis_2_butene – компонент «цис-2-бутен»;
- Component.trans_2_butene – компонент «транс-2-бутен»;
- Component.iso_butene – компонент «2-метилпропен»;
- Component.1_pentene – компонент «1-пентен»;
- Component.propadiene – компонент «пропадиен»;
- Component.1_2_butadiene – компонент «1.2-бутадиен»;
- Component.1_3_butadiene – компонент «1.3-бутадиен»;
- Component.acetylene – компонент «ацетилен»;
- Component.cyclopentane – компонент «циклопентан»;
- Component.methylcyclopentane – компонент «метилциклопентан»;
- Component.ethylcyclopentane – компонент «этилциклопентан»;
- Component.cyclohexane – компонент «циклогексан»;
- Component.methylcyclohexane – компонент «метилциклогексан»;
- Component.ethylcyclohexane – компонент «этилциклогексан»;
- Component.benzene – компонент «бензол»;
- Component.toluene – компонент «толуол»;
- Component.ethylbenzene – компонент «этилбензол»;
- Component.o_xylene – компонент «о-ксилол»;
- Component.methanol – компонент «метанол»;
- Component.methanethiol – компонент «метантиол»;
- Component.hydrogen – компонент «водород»;
- Component.water – компонент «вода»;
- Component.hydrogen_sulphide – компонент «сероводород»;
- Component.ammonia – компонент «аммиак»;
- Component.hydrocyanic_acid – компонент «цианид водорода»;
- Component.carbon_monoxide – компонент «монооксид углерода»;
- Component.carbonyl_sulfide – компонент «карбонилсульфид»;

- Component.carbon_disulfide – компонент «сероуглерод»;
- Component.helium – компонент «гелий»;
- Component.neon – компонент «неон»;
- Component.argon – компонент «аргон»;
- Component.nitrogen – компонент «азот»;
- Component.oxygen – компонент «кислород»;
- Component.carbon_dioxide – компонент «диоксид углерода»;
- Component.sulphur_dioxide – компонент «диоксид серы»;
- Component.air – компонент «воздух»;
- Component.isobutylene – компонент «изобутилен»;
- Component.acrolein – компонент «акролеин»;
- Component.c5plus – компонент «C5+»;
- Component.c6plus – компонент «C6+»;
- Component.isopropanol – компонент «изопропанол»;
- Component.tetrahydrofuran – компонент «тетрагидрофуран»;
- Component.methylacetylene – компонент «метилацетилен»;
- Component.4vinylcyclohexene – компонент «винилциклогексен»;
- Component.acetonitrile – компонент «ацетонитрил»;
- Component.acrylonitrile – компонент «нак»;
- Component.methyl_mercaptan – компонент «метилмеркаптан»;
- Component.ethyl_mercaptan – компонент «этилмеркаптан»;
- Component.propyl_mercaptan – компонент «пропилмеркаптан»;
- Component.isopropyl_mercaptan – компонент «изопропилмеркаптан»;
- Component.sec_butyl_mercaptan – компонент «втор-бутилмеркаптан»;
- Component.tert_butyl_mercaptan – компонент «трет-бутилмеркаптан»;
- Component.isobutyl_mercaptan – компонент «изобутилмеркаптан»;
- Component.butyl_mercaptan – компонент «бутилмеркаптан»;
- Component.ethanol – компонент «этанол»;
- Component.c4-1 – компонент «C4-1»;
- Component.c4-2 – компонент «C4-2»;
- Component.c4-3 – компонент «C4-3»;
- Component.c4-4 – компонент «C4-4»;
- Component.c4-5 – компонент «C4-5»;
- Component.c4-6 – компонент «C4-6»;
- Component.c4-7 – компонент «C4-7»;
- Component.c4-8 – компонент «C4-8»;
- Component.c4-9 – компонент «C4-9»;
- Component.c4-10 – компонент «C4-10»;
- Component.dimethyl_sulfide – компонент «диметилсульфид»;
- Component.methyl_ethyl_sulfide – компонент «метилэтилсульфид»;
- Component.diethyl_sulfide – компонент «диэтилсульфид»;
- Component.isobutanol – компонент «изобутанол»;
- Component.acetaldehyde – компонент «ацетальдегид»;
- Component.1,2_dichloroethane – компонент «1,2-дихлорэтан»;
- Component.dichloromethane – компонент «дихлорметан»;
- Component.carbon_tetrachloride – компонент «тетрахлорметан»;
- Component.trichloroethylene – компонент «трихлорэтилен»;
- Component.chloroform – компонент «трихлорметан»;
- Component.tetrachloroethylene – компонент «тетрахлорэтилен»;
- Component.1,1,1,2_tetrachloroethane – компонент «1,1,1,2-тетрахлорэтан»;
- Component.1,1,2,2_tetrachloroethane – компонент «1,1,2,2-тетрахлорэтан»;

- Component.pentachloroethane – компонент «пентахлорэтан»;
- Component.hexachloroethane – компонент «гексахлорэтан»;
- Component.benzyl_chloride – компонент «бензилхлорид»;
- Component.c6 – компонент «C6»;
- Component.c7 – компонент «C7»;
- Component.c7plus – компонент «C7+»;
- Component.c8 – компонент «C8»;
- Component.c9plus – компонент «C9+»;
- Component.c10 – компонент «C10»;
- Component.c6plusstar – компонент «C6+(*)»;
- Component.n_undecane – компонент «н-ундекан»;
- Component.n_dodecane – компонент «н-додекан»;
- Component.n_tridecane – компонент «н-тридекан»;
- Component.n_tetradecane – компонент «н-тетрадекан»;
- Component.n_pentadecane – компонент «н-пентадекан»;
- Component.thiophene – компонент «тиофен»;
- Component.p_xylene – компонент «п-ксилол»;
- Component.m_xylene – компонент «м-ксилол»;
- Component.styrene – компонент «стирол»;
- Component.vinylacetylene – компонент «винилацетилен»;
- Component.ethylacetylene – компонент «этилацетилен»;
- Component.dimethylacetylene – компонент «диметилацетилен»;
- Component.1_hexene – компонент «1-гексен»;
- Component.1_nonene – компонент «нонен-1»;
- Component.tert_butanol – компонент «трет-бутанол»;
- Component.2_ethyl_1_butene – компонент «2-этил-бутен-1»;
- Component.3_methyl_1_pentene – компонент «3-метил-пентен-1»;
- Component.2_ethyl_3_methyl_1_pentene – компонент «2-этил-3-метил-пентен-1»;
- Component.2_ethyl_1_hexene – компонент «2-этил-гексен-1»;
- Component.propionaldehyde – компонент «пропиональдегид»;
- Component.isobutylaldehyde – компонент «изобутиральдегид»;
- Component.butylaldehyde – компонент «бутиральдегид»;
- Component.isovaleraldehyde – компонент «изовалериановый альдегид»;
- Component.valeraldehyde – компонент «валериановый альдегид»;
- Component.aceton – компонент «ацетон»;
- Component.2_butanone – компонент «метилэтилкетон»;
- Component.dimethylether – компонент «диметиловый эфир»;
- Component.diethylether – компонент «диэтиловый эфир»;
- Component.mtbe – компонент «МТБЭ»;
- Component.etbe – компонент «ЭТБЭ»;
- Component.diispropylether – компонент «диизопропиловый эфир»;
- Component.dipropylether – компонент «дипропиловый эфир»;
- Component.tame – компонент «ТАМЭ»;
- Component.propanol – компонент «пропанол»;
- Component.allylalcohol – компонент «аллиловый спирт»;
- Component.sec_butanol – компонент «втор-бутанол»;
- Component.n_butanol – компонент «н-бутанол»;
- **ФХП по ГОСТ 31369-2008:**
- Property.Gost313692008BurnoutTemperature - температура сгорания;
- Property.Gost313692008D - относительная плотность реального газа (кг/м3);
- Property.Gost313692008D0 - относительная плотность идеального газа (кг/м3);

- Property.Gost313692008HmassN - низшая теплота сгорания массовая (МДж/кг);
- Property.Gost313692008HmassNKcal - низшая теплота сгорания массовая (ккал/кг);
- Property.Gost313692008HmassV - высшая теплота сгорания массовая (МДж/кг);
- Property.Gost313692008HmassVKcal - высшая теплота сгорания массовая (ккал/кг);
- Property.Gost313692008HmolN - низшая теплота сгорания молярная (кДж/моль);
- Property.Gost313692008HmolNCal - низшая теплота сгорания молярная (кал/моль);
- Property.Gost313692008HmolV - высшая теплота сгорания молярная (кДж/моль);
- Property.Gost313692008HmolVCal - высшая теплота сгорания молярная (кал/моль);
- Property.Gost313692008HvolN - низшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008HvolN0 - низшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008HvolN0Kcal - низшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008HvolNKcal - низшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008HvolV - высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008HvolV0 - высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008HvolV0Kcal - высшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008HvolVKcal - высшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008IsMethaneByDifference - метан по разности (0 – нет; 1 – да);
- Property.Gost313692008M - молярная масса (кг/кмоль);
- Property.Gost313692008MeasureTemperature - температура измерения;
- Property.Gost313692008Ro - плотность реального газа (кг/м³);
- Property.Gost313692008Ro0 - плотность идеального газа (кг/м³);
- Property.Gost313692008WobbeN - число воббе низшее (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008WobbeN0 - число воббе низшее (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008WobbeN0Kcal - число воббе низшее (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008WobbeNKcal - число воббе низшее (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008WobbeV - число воббе высшее (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008WobbeV0 - число воббе высшее (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008WobbeV0Kcal - число воббе высшее (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692008WobbeVKcal - число воббе высшее (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692008Zmix - коэффициент сжимаемости;
- **ФХП по ГОСТ 31369-2021:**
- Property.Gost313692021AtmosphericPressure – Атмосферное давление;
- Property.Gost313692021BurnoutTemperature – Температура сгорания;
- Property.Gost313692021D – Плотность реального газа (кг/м³);
- Property.Gost313692021D0 – Плотность идеального газа (кг/м³);
- Property.Gost313692021G – Относительная плотность реального газа;
- Property.Gost313692021G0 – Относительная плотность идеального газа;
- Property.Gost313692021HmassG – Высшая теплота сгорания массовая (МДж/кг);
- Property.Gost313692021HmassGKcal – Высшая теплота сгорания массовая

(ккал/кг);

- Property.Gost313692021HmassN – Низшая теплота сгорания массовая (МДж/кг);
- Property.Gost313692021HmassNKcal – Низшая теплота сгорания массовая (ккал/кг);
- Property.Gost313692021HmolG – Высшая теплота сгорания молярная (кДж/моль);
- Property.Gost313692021HmolGCal – Высшая теплота сгорания молярная (ккал/моль);
- Property.Gost313692021HmolN – Низшая теплота сгорания молярная (кДж/моль);
- Property.Gost313692021HmolNCal – Низшая теплота сгорания молярная (ккал/моль);
- Property.Gost313692021HvolG – Высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021HvolG0 – Высшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021HvolG0Kcal – Высшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021HvolGKcal – Высшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021HvolN – Низшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021HvolN0 – Низшая теплота сгорания объёмная (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021HvolN0Kcal – Низшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021HvolNKcal – Низшая теплота сгорания объёмная (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021IsMethaneByDifference – Метан по разности (0 – нет; 1 – да);
- Property.Gost313692021MeasureTemperature – Температура измерения;
- Property.Gost313692021Mm – Молярная масса (кг/кмоль);
- Property.Gost313692021WobbeG – Число Воббе высшее (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021WobbeG0 – Число Воббе высшее (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021WobbeG0Kcal – Число Воббе высшее (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021WobbeGKcal – Число Воббе высшее (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021WobbeN – Число Воббе низшее (МДж/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021WobbeN0 – Число Воббе низшее (МДж/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021WobbeN0Kcal – Число Воббе низшее (ккал/м³) идеального газа;
- Property.Gost313692021WobbeNKcal – Число Воббе низшее (ккал/м³) реального газа;
- Property.Gost313692021Z – Коэффициент сжимаемости;
- **ФХП по ГОСТ 34704-2020:**
- Property.Gost347042020CM – Метановое число упрощённой смеси;
- Property.Gost347042020M – Метановое число газового моторного топлива;
- **ФХП по ГОСТ 53367-2009:**
- Property.Gost533672009ButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, бутилмеркаптан, мг/м³;
- Property.Gost533672009CarbonylSulfideSulphur – Массовая концентрация серы, карбонилсульфид, мг/м³;

- Property.Gost533672009EthylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, этилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009GenericSulphur – Массовая концентрация общей серы, мг/м3;
- Property.Gost533672009HydrogenSulphideSulphur – Массовая концентрация серы, сероводород, мг/м3;
- Property.Gost533672009IsobutylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, изобутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009IsopropylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, изопропилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009MethylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, метилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009PropylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, пропилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009SecButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, втор-бутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009TertButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, трет-бутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost533672009TotalMercaptanSulphur – Суммарная массовая концентрация меркаптановой серы, мг/м3;
- Property.Gost533672009CarbonDisulfideSulphur – Массовая концентрация серы, сероуглерод, мг/м3;
- Property.Gost533672009DimethylSulfideSulphur – Массовая концентрация серы, диметилсульфид, мг/м3;
- Property.Gost533672009MethylEthylSulfideSulphur – Массовая концентрация серы, метилэтилсульфид, мг/м3;
- Property.Gost533672009DiethylSulfideSulphur – Массовая концентрация серы, диэтилсульфид, мг/м3;
- Property.Gost533672009ThiopheneSulphur – Массовая концентрация серы, тиофен, мг/м3;
- **ФХП по ГОСТ 34723-2021:**
- Property.Gost347232021ButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, бутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021CarbonylSulfideSulphur – Массовая концентрация серы, карбонилсульфид, мг/м3;
- Property.Gost347232021EthylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, этилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021GenericSulphur – Массовая концентрация общей серы, мг/м3;
- Property.Gost347232021HydrogenSulphideSulphur – Массовая концентрация серы, сероводород, мг/м3;
- Property.Gost347232021IsobutylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, изобутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021IsopropylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, изопропилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021MethylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, метилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021PropylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, пропилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021SecButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, втор-бутилмеркаптан, мг/м3;

- Property.Gost347232021TertButylMercaptanSulphur – Массовая концентрация меркаптановой серы, трет-бутилмеркаптан, мг/м3;
- Property.Gost347232021TotalMercaptanSulphur – Суммарная массовая концентрация меркаптановой серы, мг/м3;
- AvgFromDate.Year – дата и время начала усреднения, год;
- AvgFromDate.Month – дата и время начала усреднения, месяц;
- AvgFromDate.Day – дата и время начала усреднения, день;
- AvgFromDate.Hour – дата и время начала усреднения, час;
- AvgFromDate.Minute – дата и время начала усреднения, минута;
- AvgFromDate.Second – дата и время начала усреднения, секунда;
- AvgFromDate.UnixTime – дата и время начала усреднения, в формате unix time 32 бита
- Mixture.N.Ro – абсолютная плотность градуировочной смеси. Вместо N указывается номер активного баллона (на текущий момент 1 или 2);
- Mixture.N.HmolN – низшая теплота сгорания градуировочной смеси;
- Mixture.N.ExpiryDate – срок годности градуировочной смеси;
- Mixture.N.<Имя_компонента> – молярная доля компонента в градуировочной смеси. Возможные имена компонентов аналогичны Component.* (пример: Mixture.1.methane – молярная доля метана в г.с. 1);
- SystemDate.UnixTime – текущее системное время, в формате unix time 32 бита;
- IsArchiveMode – флаг переключения режима доступа к архивам усреднений (по закрытым часам/суткам):
 - 0 – текущий режим, начало усреднения автоматически рассчитывается исходя из текущего закрытого часа/текущих закрытых суток
 - 1 – архивный режим, для доступа к необходимому архивному значению необходимо записать в регистры AvgFromDate.UnixTime суточных и часовых усреднений требуемое дату/время начала усреднения в формате unix time 32 бита. После этого в соответствующих регистрах (108-200, 208-300 п. 6.3) можно считать архивные данные за последующий час/сутки. Для возврата к текущему режиму достаточно установить регистр IsArchiveMode в 0, произойдёт автоматический возврат к текущим значениям даты/времени усреднения;
- Intervention.StartDate – Чтение/запись даты/времени начала выборки записей журнала нештатных ситуаций в формате unix time 32 бита. По умолчанию – начало текущего месяца, можно задать произвольно;
- Intervention.CurrentRow – Чтение/запись номера текущей отображаемой записи в регистрах 602-608. Нумерация начинается от 1 (самое недавнее вмешательство) и до общего количества найденных записей (самое раннее от даты выборки);
- Intervention.TotalRows – Общее количество найденных записей в журнале (от заданного времени);
- Intervention.UnixTime – Дата/время выбранного вмешательства в формате unix time 32 бита;
- Intervention.Code – Код вмешательства:
 - 1 – Пользователь.Добавление;
 - 2 – Пользователь.Изменение;
 - 3 – Пользователь.Удаление;
 - 4 – Пользователь.Смена пароля;
 - 5 – Пользователь.Вход;
 - 6 – Пользователь.Выход;
 - 7 – Пользователь.Добавление неуспешно;
 - 8 – Пользователь.Изменение неуспешно;

- 9 – Пользователь.Удаление неуспешно;
- 10 – Пользователь.Смена пароля неуспешна;
- 11 – Пользователь.Вход неуспешен;
- 101 – Расчёт.Температура сгорания;
- 102 – Расчёт.Температура измерения;
- 103 – Расчёт.Расчетное время;
- 104 – Расчёт.Корректировка по атмосферному давлению;
- 105 – Расчёт.Градуировка одна для всех потоков;
- 106 – Расчёт.Метан по разности;
- 107 – Расчёт.Нормализация;
- 108 – Расчёт.Добавление условно-постоянного компонента;
- 109 – Расчёт.Изменение условно-постоянного компонента;
- 110 – Расчёт.Удаление условно-постоянного компонента;
- 111 – Расчёт.Игнорировать отсутствие в анализе компонентов градуировочной смеси;
- 112 – Расчёт.Добавление единицы измерения компонента;
- 113 – Расчёт.Изменение единицы измерения компонента;
- 114 – Расчёт.Удаление единицы измерения компонента;
- 115 – Расчёт.Использовать время обработки;
- 116 – Расчёт.Основное вещество;
- 201 – Запуск.Автоматизация;
- 202 – Запуск.Время продувки;
- 203 – Запуск.Время продувки (градуировка);
- 204 – Запуск.Время кондиционирования;
- 205 – Запуск.При неприемлемой градуировке;
- 206 – Запуск.Выключать прибор по уровню водорода;
- 207 – Запуск.% от НКПР водорода для выключения;
- 208 – Запуск.Частота опроса датчика водорода;
- 209 – Запуск.Последовательный режим;
- 210 – Запуск.Задержка после запуска измерения;
- 211 – Запуск.Источник данных о давлении;
- 212 – Запуск.Датчик водорода;
- 301 – Градуировочные смеси.Добавление смеси;
- 302 – Градуировочные смеси.Изменение смеси;
- 303 – Градуировочные смеси.Удаление смеси;
- 401 – Планировщик.Добавление задания;
- 402 – Планировщик.Изменение задания;
- 403 – Планировщик.Удаление задания;
- 501 – Относительные коэффициенты чувствительности.Добавление таблицы;
- 502 – Относительные коэффициенты чувствительности.Изменение таблицы;
- 503 – Относительные коэффициенты чувствительности.Удаление таблицы;
- 601 – Система.Изменение системной даты/времени;
- 701 – Группы компонентов.Добавление группы;
- 702 – Группы компонентов.Изменение группы;
- 703 – Группы компонентов.Удаление группы;
- 801 – Пересчёты компонентов.Добавление пересчёта;
- 802 – Пересчёты компонентов.Изменение пересчёта;
- 803 – Пересчёты компонентов.Удаление пересчёта;
- 804 – Источники внешних параметров.Добавление источника;
- 805 – Источники внешних параметров.Изменение источника;
- 806 – Источники внешних параметров.Удаление источника;

- 901 – Bot.Метод для задания Охлаждение;
- 902 – Bot.Метод для задания Кондиционирование;
- 903 – Bot.Время ожидания выполнения задания (в секундах);
- 904 – Bot.Время ожидания выполнения кондиционирования (в секундах);
- 905 – Bot.Количество потоков для обработки очереди заданий;
- 906 – Bot.Размер очереди заданий;
- 907 – Bot.Тип пробоподготовки;
- 908 – Bot.Сетевая пробоподготовка.Имя хоста;
- 909 – Bot.Сетевая пробоподготовка.Порт;
- 910 – Bot.Сетевая пробоподготовка.Стартовый адрес;
- 911 – Bot.Сетевая пробоподготовка.Количество потоков;
- 912 – Bot.Сетевая пробоподготовка.Линейная схема;
- 913 – Bot.Частота опроса датчиков (в секундах);
- 914 – Bot.Поток для переключения после окончания градуировки;
- 915 – Bot.Каталог для экспорта базы данных;
- 916 – Bot.Добавление привязки метода к каналу и потоку;
- 917 – Bot.Изменение привязки метода к каналу и потоку;
- 918 – Bot.Удаление привязки метода к каналу и потоку;
- 919 – Bot.Добавление датчика;
- 920 – Bot.Изменение датчика;
- 921 – Bot.Удаление датчика;
- 928 – Bot.Вывод ошибок на DO Платы управления клапанами;
- 929 – Bot.Настройки DO Платы управления клапанами;
- Intervention.OldValue – Старое значение параметра (для составных объектов, таких как внешние компоненты, градуировочные смеси, задания планировщика, таблицы коэффициентов чувствительности не указывается);
- Intervention.NewValue – Новое значение параметра (для составных объектов не указывается);
- ErrorMessage.StartDate – Чтение/запись даты/времени начала выборки записей журнала нештатных ситуаций в формате unix time 32 бита. По умолчанию – начало текущего месяца, можно задать произвольно;
- ErrorMessage.CurrentRow – Чтение/запись номера текущей отображаемой записи в регистрах 702-706. Нумерация начинается от 1 (самая недавняя нештатная ситуация) и до общего количества найденных записей (самая ранняя от даты выборки);
- ErrorMessage.TotalRows – Общее количество найденных записей в журнале (от заданного времени);
- ErrorMessage.UnixTime – Дата/время выбранной ошибки в формате unix time 32 бита;
- ErrorMessage.Type – Тип ошибки:
 - 1 – ошибка прибора ;
 - 2 – ошибка автоматизации;
- ErrorMessage.Code – Код ошибки:
 - Для ошибок с типом 1 коды ошибок соответствуют параметру Error.Chromos;
 - Для ошибок с типом 2 коды ошибок соответствуют параметру Error.Bot;
- ContractHour – Контрактный (расчётный) час для расчёта усреднений. Значения 0-23.